

Prestatiekenmerken

INHOUD

1	DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED	5
2	TERMEN EN DEFINITIES	6
2.1	<i>Juistheid (Eng: Trueness)</i>	6
2.2	<i>Precisie (Eng.: Precision)</i>	7
2.3	<i>Herhaalbaarheid (Eng: Repeatability)</i>	7
2.4	<i>Reproduceerbaarheid (Eng.: Reproducibility)</i>	7
2.5	<i>Meetonzekerheid (Eng: Expanded uncertainty)</i>	8
2.6	<i>Selectiviteit en specificiteit (Eng: Selectivity, Specificity)</i>	8
2.7	<i>Aantoonbaarheidsgrens (Eng: Limit of detection)</i>	8
2.8	<i>Bepalingsgrens (Eng: Limit of quantitation)</i>	9
2.9	<i>Lineariteit (Eng: Linearity)</i>	9
2.10	<i>Werkgebied of bereik (Eng: Range, Measuring range, Working range)</i>	9
2.11	<i>Robuustheid (Eng: Ruggedness, Robustness)</i>	10
2.12	<i>Analyse</i>	10
3	ALGEMEEN VALIDATIEPLAN	11
3.1	<i>Selectie van de te bepalen prestatiekenmerken</i>	11
3.2	<i>Bepaling van het toepassingsgebied en eventuele deelgebieden bij de validatie</i>	12
3.3	<i>Omgang met externe eisen</i>	13
3.4	<i>Keuze van de monsters voor een validatieonderzoek</i>	13
4	ALGEMENE PROCEDURE VOOR DE BEPALING VAN DE AFZONDERLIJKE PRESTATIEKENMERKEN	14
4.1	<i>Juistheid</i>	14
4.1.1	<i>Meervoudige analyse van een referentiemateriaal</i>	15
4.1.2	<i>Terugvindingsexperimenten op een geselecteerd monster</i>	15
4.1.3	<i>Evaluatie van de terugvinding en/of afwijking ten opzichte van de referentiewaarde voor verschillende monsters</i>	16
4.2	<i>Herhaalbaarheid en intra-reproduceerbaarheid</i>	17
4.2.1	<i>Meervoudige analyse van hetzelfde monster</i>	17
4.2.2	<i>Duplo-analyse van verschillende monsters</i>	17
4.3	<i>Selectiviteit en robuustheid</i>	18
4.4	<i>Aantoonbaarheidsgrens en bepalingsgrens</i>	19
4.4.1	<i>Meervoudige analyse van een praktijkmonster met laag gehalte</i>	19
4.4.2	<i>Duplo-analyse van verschillende praktijkmonsters met laag gehalte</i>	20
4.5	<i>Lineariteit - modelafwijking</i>	20
4.6	<i>Werkgebied</i>	22
5	EISEN INZAKE VALIDATIE VAN DE ANALYSEPAKKETTEN VOOR AFVALSTOFFEN EN BODEM	22

6	REFERENTIES	23
	BIJLAGE A PAKKETTEN WAARVOOR LABORATORIA KUNNEN ERKEND WORDEN	25
	BIJLAGE B METHODEVALIDATIE VAN ANALYSEPAKKET MET HOOFDMATRI(X)CES EN BIJHORENDE MONSTERTYPES	34
B.1	Algemeen overzicht per pakket	34
B.2	Pakket A.2	35
B.2.1	Pakket A.2.1	35
B.2.2	Pakket A.2.2	36
B.2.3	Pakket A.2.3	36
B.2.4	Pakket A.2.4	36
B.3	Pakket A.3	37
B.3.1	Pakket A.3.1	37
B.3.2	Pakket A.3.2	37
B.3.3	Pakket A.3.3	37
B.3.4	Pakket A.3.4	37
B.3.5	Pakket A.3.5	37
B.4	Pakket A.4	37
B.5	Pakket A.5	39
B.6	Pakket A.6	39
B.7	Pakket A.7	39
B.8	Pakket B.1, B.4, B.5, B.6, B.7 en B.8	39
	BIJLAGE C RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT ADDITIE	40
C.1	ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR ADDITIE	40
C.2	SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR ADDEREN VAN VERSCHILLENDE MATRICES VOOR ORGANISCHE PARAMETERS	40
C.2.1	Adderen aan vaste materialen	40
C.2.2	Adderen aan vloeistoffen	40
	BIJLAGE D MINIMALE EISEN MET BETREKKING TOT RAPPORTAGEGRENZEN	42
D.1	Pakket A.2.1 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – monstertype compost	42
D.2	Pakket A.2.1 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – anorganische VLAREMA parameters	43
D.3	Pakket A.2.2 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – organische parameters	43
D.4	Pakket A.2.4 PFAS in meststof/bodemverbeterend middel	45

D.5	Pakket A.3.4 Gebruik als bouwstof – pasteus en vast	48
D.6	Pakket A.3.3 Fysische verontreinigingen	51
D.7	Pakket A.4 Verbranden – olie, pasteus en vast	51
D.8	Pakket A.5.1 stortplaatsen – pasteus en vast	53
D.9	Pakket A.5.2 stortplaatsen – pasteus en vast	54
D.10	Pakket G.1 Grondwater en B.1 Bodem	56
D.11	Pakket A.7 Asbest	61
D.12	Pakket B.4 Asbest in bodem	61
D.13	Pakket B.5 Waterbodem	61
D.14	Pakket B.6 Gebruik van bodemmaterialen	63
D.15	Pakket B.7 Storten van bodemmaterialen	63
D.16	Pakket B.8 PFAS in bodem en waterbodem	64
D.17	Pakket G.2 PFAS in grondwater	65
	BIJLAGE E MINIMALE EISEN MET BETREKKING TOT MEETONZEKERHEDEN	66
E.1	Pakket A.2.1 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel - Compost	66
E.2	Pakket A.2.1 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – zuiveringsslib	66
E.3	Pakket A.2.2 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – organische parameters	67
E.4	Pakket A.3.4 Gebruik als bouwstof – pasteus en vast	67
E.5	Pakket A.4 Verbranden – olie, pasteus en vast	69
E.6	Pakket A.5.1 Storten – pasteus en vast	70
E.7	Pakket A.5.2 Storten – pasteus en vast	70

1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze procedure vervangt de procedure CMA/6/A van juni 2024.

Het toepassingsgebied is verruimd tot alle analysemethoden. De aanpak voor het onderzoek inzake de gelijkwaardigheid van methoden wordt niet meer opgenomen vermits een statistische benadering voor gelijkwaardigheid een aantal beperkingen inhoudt qua matrices, concentratiegebied, enz. Het oordeel van expert(en) is doorslaggevend voor de uitspraak inzake de gelijkwaardigheid van analysemethoden.

Analyseresultaten zijn slechts benaderingen van de ware waarde. De mate waarin analyseresultaten kunnen afwijken wordt gekwantificeerd met prestatiekenmerken. Zij weerspiegelen de prestatie (performantie) van een analysemethode onder verschillende omstandigheden. Het maatschappelijk belang van metingen maakt het noodzakelijk om voldoende inzicht te hebben in de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte analysemethoden.

De validatie van een analysemethode wordt gedefinieerd als het aantonen dat de (beschreven) analysemethode geschikt is voor de beoogde toepassing. Dit impliceert het vaststellen van de relevante prestatiekenmerken van de analysemethode en het evalueren van de geschiktheid voor het beoogde doel. Dit wordt in ISO 8402 als volgt verwoord: 'confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirements for a specified intended use are fulfilled'. Hierbij dient vermeld te worden dat in de huidige praktijk er niet steeds duidelijkheid is betreffende externe eisen (uit regelgeving, contracten, ...) en de status ervan.

Methoden moeten gevalideerd worden telkens wanneer het nodig is om te verifiëren dat de prestatiekenmerken geschikt zijn voor toepassing bij een specifiek analytisch probleem. Dit is bijvoorbeeld zo voor nieuwe analysemethoden die met een bepaald doel ontwikkeld zijn, maar ook voor reeds gevalideerde analysemethoden die aangepast of uitgebreid worden, die blijkens de kwaliteitscontrole met de tijd veranderen, die in een ander laboratorium of door andere analisten of met andere apparatuur gebruikt worden, De verkregen prestatiekenmerken zijn daarom alleen geldig voor het desbetreffende laboratorium, en de uitvoeringsomstandigheden (analysemethode, ...) dienen hierbij te zijn vastgelegd. De uitgebreidheid van een (her)validatie hangt af van de mate van verandering. Eurachem en de nationale accreditatie-organismen zoals Belac stellen dat een minimale validatie steeds aangewezen is, ook indien een genormeerde analysemethode toegepast wordt.

Met betrekking tot de te valideren parameters kan men een onderscheid maken tussen kwalitatieve analysemethoden, kwantitatieve analysemethoden op hoog concentratieniveau en kwantitatieve analysemethoden op laag concentratieniveau. De meerderheid van de milieu-analysemethoden behoren tot laatstgenoemde categorie en bijgevolg is deze procedure ook hoofdzakelijk op dit type methoden gericht. Algemeen dient bij dergelijke validatie steeds maximale aandacht aan juistheid en precisie geschonken te worden en, indien relevant, ook aan de aantoonbaarheidsgrens.

Van elk validatieonderzoek wordt een apart rapport gemaakt, dat voldoet aan vooraf vastgelegde regels wat betreft opbouw, inhoud, beoordeling, goedkeuring en archivering.

Deze procedure behandelt enkel de intralaboratoriumvalidatie van analysemethoden voor fysische en chemische univariate grootheden. Voor de bepaling van prestatiekenmerken voor een groep van laboratoria worden o.a. in ISO 5725 procedures gegeven; de bepaling van dergelijke prestatiekenmerken vergt interlaboratoriumonderzoek.

2 TERMEN EN DEFINITIES

2.1 JUISTHEID (ENG: TRUENESS)

De juistheid van een analysemethode is de mate van overeenstemming tussen het gemiddelde van een reeks meetwaarden en de werkelijke waarde of de als werkelijk aangenomen waarde van de te bepalen grootte (cfr. ISO 3534-1). De gebruikelijke maat voor de juistheid is de bias b , die dus overeenkomt met de (positieve of negatieve) systematische fout¹.



De verwijzing van juistheid naar de term accuraatheid (Eng. Accuracy), nauwkeurigheid of een afgeleide ervan wordt door Eurachem ontraden. In hun meest gangbare betekenis omvatten deze termen een combinatie van 'random' componenten en de 'bias' component, en sluiten ze dus meer aan bij de term meetonzekerheid.

Met de term terugvinding T (Eng: Recovery) wordt de fractie van de component bedoeld die bij analyse wordt teruggevonden, na toevoeging onder gedefinieerde omstandigheden van een bekende hoeveelheid component aan het monster. In dit document worden terugvindingsexperimenten als één van de mogelijke werkwijzen voor bepaling van de juistheid van een analysemethode beschouwd en wordt geen systematisch onderscheid gemaakt tussen de termen juistheid en terugvinding.

In het geval een (referentie)methode wordt opgelegd voor het meten van een welbepaalde grootte, kan juistheid eveneens worden geïnterpreteerd als zijnde de mate van overeenstemming tussen de meetwaarde van het laboratorium en de als werkelijk aangenomen waarde van de te bepalen grootte met dezelfde methode (gewoonlijk volgend uit een interlaboratoriumvergelijking). In dit geval spreekt men van de bias ten opzichte van een methodegemiddelde. De keuze van de te rapporteren bias dient uit de context van de analyse-aanvraag duidelijk te zijn, en zonodig afgesproken te worden met de klant.

Er kan verder een opsplitsing gemaakt worden tussen twee gevallen van bias, namelijk constante absolute bias en proportionele bias. Bij proportionele bias is de relatieve afwijking op ieder concentratieniveau constant en wordt deze procentueel uitgedrukt. In het geval van absolute constante bias is de afwijking op ieder concentratieniveau, absoluut uitgedrukt, even groot. Onderstaande grafieken verduidelijken beide gevallen van juistheidseffecten ten opzichte van het ideale geval (diagonaal). Voor hogere gehalten overheerst het proportionele deel van de juistheid meestal het constante deel. Voor gehalten nabij de aantoonbaarheidsgrens spelen proportionele juistheidseffecten een ondergeschikte rol.

¹ In principe is de systematische afwijking een gemiddelde dat het resultaat is van een oneindig aantal metingen van dezelfde meetgrootte, uitgevoerd onder herhaalbaarheidscondities, verminderd met de ware waarde van de meetgrootte (cfr. NPR 2814).

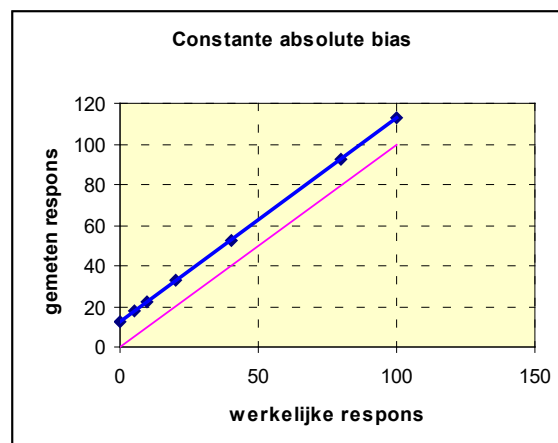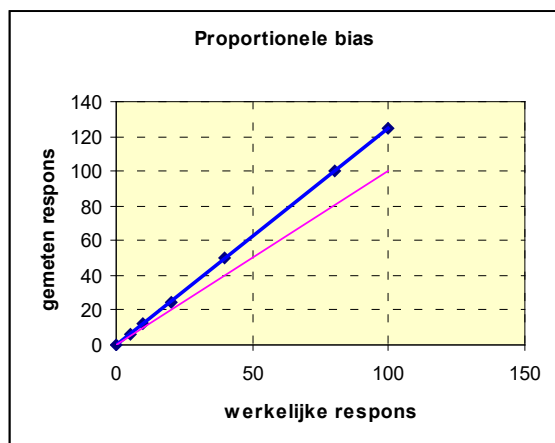

2.2 PRECISIE (ENG.: PRECISION)

De precisie van een analysemethode is de mate van spreiding in de analyseresultaten die verkregen worden door de analysemethode een herhaald aantal malen onder vastgelegde condities op hetzelfde monster uit te voeren (cfr. ISO 3534-1). De gebruikelijke maat voor de precisie is de standaardafwijking of de variatiecoëfficiënt (relatieve standaardafwijking) van de testresultaten, dit wil zeggen dat de precisie wordt uitgedrukt als imprecisie. Naar de condities wordt normaal gerefereerd met de termen herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid.

2.3 HERHAALBAARHEID (ENG: REPEATABILITY)

Met herhaalbaarheid wordt bedoeld de precisie verkregen bij uitvoering van alle betreffende metingen door dezelfde analist, met dezelfde meetapparatuur, op zo dicht mogelijk bij elkaar gelegen tijdstippen (cfr. ISO 3534-1). De gebruikelijke maat is de herhaalbaarheidsstandaardafwijking s_r of de herhaalbaarheidsvariatiecoëfficiënt CV_r .

2.4 REPRODUCEERBAARHEID (ENG.: REPRODUCIBILITY)

Met reproduceerbaarheid wordt bedoeld de precisie verkregen bij uitvoering van alle betreffende metingen onder variabele omstandigheden, dit wil zeggen in verschillende laboratoriumruimten, door verschillende analisten, met verschillende apparaten en batches reagentia/standaarden, op verschillende tijdstippen met grotere tussenpozen (cfr. ISO 3534-1). Bij een uitspraak met betrekking tot reproduceerbaarheid dient bijgevolg aangegeven te worden welke condities veranderd werden.

Deze procedure richt zich enkel op de reproduceerbaarheid binnen een bepaald laboratorium (kortweg intra-reproduceerbaarheid), en als minimale eis hiervoor wordt vooropgesteld dat de factor tijd gevarieerd wordt, met andere woorden dat de betreffende analyses op verschillende dagen en in verschillende analysereeksen worden uitgevoerd (Eng.: Time-dependent intermediate precision). De gebruikelijke maat is de intra-reproduceerbaarheidsstandaardafwijking s_R of de intra-reproduceerbaarheids-variatiecoëfficiënt CV_R .

2.5 MEETONZEKERHEID (ENG: EXPANDED UNCERTAINTY)

De meetonzekerheid U wordt gedefinieerd als de halve lengte van een interval waarbinnen de ware waarde wordt verwacht te liggen, en dit bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau. In ISO GUM wordt dit als volgt verwoord: 'Quantity defining an interval about a result of a measurement that may be expected to encompass a large fraction of the distribution of values that could reasonably be attributed to the measurand'.

In principe dient de meetonzekerheid alle factoren te omvatten die van invloed zijn op het resultaat, gecombineerd volgens gevestigde procedures. Relevante factoren zijn:

- de monsterbewaring in het laboratorium;
- de initiële monstervoorbehandeling (bijv. homogenisatie, droging, deelmonsterneming, ...);
- de monstervoorbereiding (bijv. extractie, ontsluiting, zuiveringen, ...);
- de eigenlijke meting van het preparaat (bijv. kalibratie, interferenties, ...) en
- de berekening van het analyseresultaat (bijv. correcties, ...).

In het kader van deze procedure is er van uitgegaan dat de meetonzekerheid zich beperkt tot het eigenlijke laboratoriumgebeuren (d.w.z. de vijf hoger vermelde stappen) en dat factoren zoals de monsterneming zelf (bijv. representativiteit, ...) en het transport van het monster naar het laboratorium (bijv. conservering, ...) niet per definitie opgenomen worden in de meetonzekerheid.

De prestatiekenmerken die de meetonzekerheid - of tenminste een gedeelte ervan - bepalen zijn de intra-reproduceerbaarheid van de analysemethode (voor wat de toevallige afwijking betreft) en de juistheid van de analysemethode (voor wat de systematische afwijking betreft). Door het in rekening brengen van een factor (Eng. coverage factor) op de toevallige afwijking wordt de waarschijnlijkheid dat de ware waarde in het interval ligt voldoende groot gemaakt.

Merk op dat meetonzekerheid geen prestatiekenmerk is, maar een karakteristiek van een meetwaarde. Mede om deze reden wordt meetonzekerheid in een apart deel nader bekeken (zie CMA/6/B).

2.6 SELECTIVITEIT EN SPECIFICITEIT (ENG: SELECTIVITY, SPECIFICITY)

De selectiviteit van een analysemethode is de (on)afhankelijkheid van een andere grootheid dan de meetgrootte, met andere woorden de mate waarmee ze de te bepalen component in een mengsel of matrix kan onderscheiden van andere bestanddelen (cfr. IUPAC, ontwerp-NEN 7777). Bij een voldoende selectieve analyse worden de bepalingcondities zo gekozen dat de bijdragen van andere bestanddelen geëlimineerd worden of binnen de onzekerheidsmarge vallen. Deze potentiële bijdragen betreffen zowel interferenties (vanwege grootheden die zelf een signaal veroorzaken) als matrixeffecten (vanwege grootheden die het signaal van de meetgrootte veranderen).

Een analysemethode is specifiek als ze enkel reageert op de te bepalen component (cfr. AOAC, IUPAC). Specificiteit kan dus beschouwd worden als de ultieme selectiviteit. Het gebruik van deze term wordt door IUPAC ontraden.

2.7 AANTOONBAARHEIDSGRENS (ENG: LIMIT OF DETECTION)

De aantoonbaarheidsgrens AG (ook wel detectielimiet genoemd) is de kleinste hoeveelheid stof of laagste concentratie van de component in het monster die met een bepaalde (en redelijke) statistische waarschijnlijkheid met de analysemethode aangetoond kan worden, met andere

woorden waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde (on)zekerheid kan worden vastgesteld (cfr. AOAC, IUPAC). Het is bijgevolg een kwalitatief criterium.

In de gebruikelijke operationele definitie wordt het aspect waarschijnlijkheid in rekening gebracht door de aantoonbaarheidsgrens gelijk te stellen aan 3 maal de standaardafwijking op dit niveau (cfr. IUPAC). De aantoonbaarheidsgrens is aldus de waarde van de meetgrootte waarbij de variatiecoëfficiënt bij conventie 33% bedraagt. Voor meer achtergrondinformatie hieromtrent wordt verwezen naar ontwerp NEN 7777 en de daarin opgenomen referenties.

2.8 BEPALINGSGRENS (ENG: LIMIT OF QUANTITATION)

De bepalingsgrens, BG, wordt gedefinieerd als de kleinste hoeveelheid stof of laagste concentratie van de component in het monster die met een bepaalde (en redelijke) precisie en juistheid met de analysemethode gekwantificeerd kan worden, met andere woorden waarvan de meetwaarde nog met een bepaalde (on)zekerheid kan worden vastgesteld. In tegenstelling tot de aantoonbaarheidsgrens is de bepalingsgrens een kwantitatief criterium.

Pragmatisch wordt de bepalingsgrens in het kader van deze procedure gelijk gesteld aan 6 maal de standaardafwijking in eenheden van de meetgrootte. Bijgevolg is de bepalingsgrens die waarde van de meetgrootte waarbij de variatiecoëfficiënt 17% bedraagt.

2.9 LINEARITEIT (ENG: LINEARITY)

De lineariteit van een analysemethode is de eigenschap dat binnen vastgelegde grenzen er een rechtlijnig verband bestaat tussen de respons en de hoeveelheid (concentratie) van de te bepalen component. Het lineair gebied is het overeenkomstig werkgebied.

Indien niet aan lineariteit is voldaan, dient het werkgebied te worden versmald of moet worden overgeschakeld op een andere (bv. kwadratische) functie tussen respons en hoeveelheid (concentratie) van de te bepalen component.

Met het begrip modelafwijking wordt algemeen de afwijking ("lack of fit") bedoeld van het aangenomen verband tussen meetgrootte en respons.


2.10 WERKGEBIED OF BEREIK (ENG: RANGE, MEASURING RANGE, WORKING RANGE)

Als extrapolatie van de IUPAC-definitie die instrumentgericht is, wordt het werkgebied van een analysemethode gedefinieerd als het interval tussen de kleinste en de grootste hoeveelheid (concentratie) van de te bepalen component waarvoor de analysemethode gevalideerd is, met andere woorden waarbinnen de prestatiekenmerken aan gedefinieerde eisen voldoen.

Hieruit volgt dat een werkgebied meestal vooropgesteld wordt bij het begin van het validatieonderzoek, rekening houdend met bv. toestelgegevens, verwachte gehalten in monsters, van toepassing zijnde regelgeving, Bij een optimaal werkgebied kunnen courante concentraties probleemloos worden gemeten en liggen kritische (cfr. regelgeving) concentraties niet helemaal aan de uitersten van het werkgebied.

Men noemt een werkgebied homogeen indien over het hele werkgebied de standaardafwijking (standaard deviatie) constant is (homoscedasticiteit of homogeniteit van de varianties). In praktijk is dit zelden het geval, behalve bij kleine werkgebieden; meestal is in het bovenste deel van het

werkgebied de relatieve standaardafwijking constant (variatiecoëfficiënt) en neemt met andere woorden de standaardafwijking proportioneel toe met de concentratie.

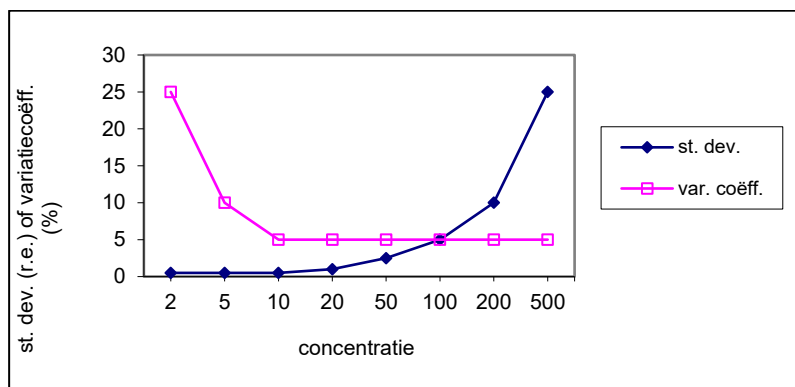

r.e.: respons eenheid

2.11 ROBUUSTHEID (ENG: RUGGEDNESS, ROBUSTNESS)

Onder robuustheid van een methode wordt de ongevoeligheid van het analyseresultaat verstaan voor kleine variaties in uitvoering, omstandigheden en hoedanigheid van afvalstoffen, zoals deze in de praktijk kunnen voorkomen (cfr. AOAC, ontwerp-NEN 7777).

2.12 ANALYSE

In het kader van validatie-experimenten komt het begrip analyse, zoals verder in de tekst vermeld, neer op het zo getrouw mogelijk uitvoeren van de volledige reeks stappen welke een routinemonster in het laboratorium ondergaat, van de gebruikelijke monstervoorbehandeling (deelmonsterneming, ...) tot en met de meting en berekening. Op die manier omvatten de prestatiekenmerken en de meetonzekerheid het gehele laboratoriumgebeuren en karakteriseren ze op een correcte wijze de analysemethode, respectievelijk de meetwaarden, van het laboratorium.

Wat de monstervoorbehandeling betreft komen typisch volgende situaties voor:

- in routine ondergaat het laboratoriummonster in zijn geheel een bepaalde monstervoorbehandeling (homogenisatie, droging, ...) vooraleer een analyseportie wordt afgenomen: in dat geval wordt bij de validatie-experimenten voor elke bepaling uitgegaan van een nieuwe portie van het aldus initieel voorbehandelde monster en volgt deze portie verder volledig de voor routinemonsters gebruikelijke werkwijze;
- in routine wordt uit het laboratoriummonster op welbepaalde wijze een deelmonster genomen, dat vervolgens een verdere voorbehandeling (droging, ...) ondergaat of rechtstreeks gebruikt wordt bij de monstervoorbereiding: in dat geval wordt bij de validatie-experimenten voor elke bepaling uitgegaan van een nieuw, op de gebruikelijke manier bekomen, deelmonster uit het laboratoriummonster en volgt dit verder volledig de voor routinemonsters gebruikelijke werkwijze.

Voor de bepaling van parameters waarvoor het hele monster dient in behandeling te worden genomen of die onmiddellijke analyse vereisen (bv. zwevend stof, biologisch zuurstof verbruik, vluchtige organische stoffen...) kan het noodzakelijk zijn om - in het kader van validatie experimenten - bij de monsternamen verschillende deelmonsters te voorzien.

3 ALGEMEEN VALIDATIEPLAN

In het algemeen worden bij validatieonderzoek de volgende stappen doorlopen (cfr. ontwerp-NEN 7777):

- bepaal op basis van het doel en de status van de analysemethode welke prestatiekenmerken bepaald moeten worden;
- bepaal het toepassingsgebied (matrices en werkgebied) waarvoor de analysemethode gevalideerd moet worden, en in hoeveel deelgebieden dit praktisch moet opgesplitst worden;
- ga na of er externe eisen gelden voor (een deel van) de prestatiekenmerken, en zo ja welke vorm deze hebben;
- ga na welke monsters nodig zijn voor het validatieonderzoek;
- voer het validatieonderzoek uit;
- beoordeel de vastgestelde prestatie in vergelijking met eventuele externe eisen, of (bij ontbreken van externe kwantitatieve eisen) rechtstreeks ten opzichte van het gebruiksdoel;
- rapporteer de resultaten in een validatierapport.

3.1 SELECTIE VAN DE TE BEPALEN PRESTATIEKENMERKEN

Welke prestatiekenmerken bepaald dienen te worden, is vooral afhankelijk van de status van de analysemethode die men wenst uit te voeren.

Voor volledig nieuwe analysemethoden (d.w.z. door het laboratorium geheel zelf ontwikkeld en niet eerder gevalideerd) geldt dat een complete validatie is vereist. Deze omvat altijd de volgende prestatiekenmerken:

- werkgebied;
- juistheid;
- intra-reproduceerbaarheid;
- selectiviteit;
- robuustheid.

indien relevant omvat deze verder:

- aantoonbaarheids- en bepalingsgrens;
- herhaalbaarheid;
- lineariteit, of meer algemeen modelafwijking.

Meestal echter zullen laboratoria bij voorkeur de referentiemethoden overnemen. Dit zijn wettelijk vastgelegde of door de bevoegde overheid aanbevolen analysemethoden, vastgelegd in bijvoorbeeld een compendium of in internationale normen. Indien zulke analysemethode zonder wijzigingen wordt overgenomen, volstaat het in principe aan te tonen dat de essentiële prestatiekenmerken in overeenstemming zijn met de gedocumenteerde en/of met het gebruiksdoel. De uit te voeren validatie omvat dan minimaal:

- juistheid;
- intra-reproduceerbaarheid.

en indien relevant tevens:

- werkgebied;
- aantoonbaarheids- en bepalingsgrens;
- herhaalbaarheid;
- selectiviteit.

Voor een gewijzigde analysemethode, d.i. een analysemethode die reeds was gevalideerd maar waarin een verandering is aangebracht, is een hervalidatie nodig gericht op die prestatiekenmerken die redelijkerwijs door de verandering kunnen beïnvloed worden.

3.2 BEPALING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED EN EVENTUELE DEELGEBIEDEN BIJ DE VALIDATIE

Prestatiekenmerken hebben slechts betekenis bij ondubbelzinnig gedefinieerde analyseobjecten en analyseresultaten. Als de analyseprocedure hierover onvoldoende duidelijkheid verschaft, dient voorafgaand aan de validatie een duidelijke interpretatie te worden opgesteld en opgenomen in het validatierapport. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal onderliggende metingen van een analyseresultaat (één of gemiddelde) en voor eventuele toegepaste correcties (voor extractiestandaarden, procedureblanco, ...). Ook het beoogde toepassingsgebied moet van tevoren worden gespecificeerd, nl. welke matrices (inclusief mogelijke interferenten) en welk werkgebied (eventueel per matrix).

Uitgangspunt is dat bij validatie gelijkaardige matrices zoveel mogelijk worden gecombineerd in één toepassingsgebied. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn verschillende deelgebieden (zowel qua matrix als werkgebied) te onderscheiden en afzonderlijk te valideren. De belangrijkste overweging hierbij is voorkennis van, of twijfel over, de effecten van bepaalde interferenten.

In bepaalde gevallen kan worden volstaan met een validatie in de “moeilijkste” matrix. Dit geldt enkel voor zover sprake is van een ondubbelzinnige gradatie, en dient zonodig per prestatiekenmerk bekeken te worden. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van sterk matrixbelaste afvalwaters om een methode te valideren voor huishoudelijk en industrieel afvalwater, percolaatwater van stortplaatsen, eluaten en dergelijke, en kan de op basis van zulke monsters bekomen precisie eventueel aangewend worden als een “worst case” waarde voor het betreffende concentratiebereik in andere watertypes zoals grondwater, oppervlaktewater en drinkwater.

Globaal wordt voor de afzonderlijk te beschouwen matrices bij de validatie van analysemethoden voor vaste/pasteuze en vloeibare milieumatrices volgende vuistregel vooropgesteld:

vloeistoffen:

- water en waterige oplossingen: hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
 - drinkwater
 - afvalwater
 - bijkomend dienen specifieke prestatiekenmerken in oppervlaktewater en/of grondwater (met betrekking tot bodemsanering) onderzocht te worden, voor zover niet gedekt door de reeds gevalideerde matrices, tevens is aanvullend onderzoek met betrekking tot specifieke interferenten nodig voor zover van toepassing (bijvoorbeeld zeewater, zwembadwater, dunne fractie digestaat...)
- organische vloeistoffen (afgewerkte olie, ...)

vaste/pasteuze stoffen : hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volgende vier hoofdmatrixes :

- vaste afvalstoffen (bouw- en sloopafval, as en slakken, shredderafval, houtafval, compost, ...)
- pasteuze afvalstoffen (zuiveringsslib, bagger- en ruimingsspecie, dierlijk vetafval, dikke fractie digestaat, ...)
- bodem

Er wordt aangeraden om minimaal voor de vaste en pasteuze afvalstoffen voor één representatief monstertype uit het normale monsteraanbod de methode volledig te valideren. Een aanvullende

controle van de methode is aangewezen op minstens 5 reële monsters, uit het normale monsteraanbod met verschillende herkomst/aard, via bijvoorbeeld duplo-analyses, standaardadditie, gebruik van interne standaarden, herextractie en dergelijke.

Voor de erkenning van laboratoria door de OVAM zijn verschillende analysepakketten door de minister vastgelegd. Deze analysepakketten zijn gebaseerd op de wetgevingen (VLAREA, VLAREBO en VLAREM) en niet op de betreffende hoofdmatrices of parameters. Afspraken in verband met de nodige methodevalidatie per analysepakket voor de hoofdmatri(x)ces en bijhorende monstertypes zijn terug te vinden in bijlage A.

3.3 OMGANG MET EXTERNE EISEN

Omdat de waarde van een prestatiekenmerk wordt verkregen door metingen, is hiermee een onzekerheid verbonden. Dit is vooral van belang wanneer moet getoetst worden of aan extern opgelegde absolute grenswaarden voldaan is. In dat geval moet aangetoond worden dat het prestatiekenmerk met een betrouwbaarheid van tenminste 95% voldoet aan de eis, met andere woorden dat de numerieke waarde van het prestatiekenmerk plus (resp. minus) de onzekerheid kleiner (resp. groter) is dan de bovengrens (resp. ondergrens).

Traditioneel worden externe eisen echter meestal als een zogenaamde geschatte grenswaarde beschouwd en kan worden volstaan met het rechtstreeks vergelijken van de numerieke waarde van het prestatiekenmerk met de grenswaarde.

In de regel geldt dat eventuele uitbijters in de verzamelde analyseresultaten alleen worden verwijderd als de oorzaak bekend is en deze niet de praktijksituatie weerspiegelt (bv. foutieve preparatie van een synthetisch monster, technisch defect meettoestel, ...).

3.4 KEUZE VAN DE MONSTERS VOOR EEN VALIDATIEONDERZOEK

Als algemene regel geldt dat de monsters zoveel mogelijk representatief moeten zijn voor het toepassingsgebied (of het deelgebied). In de verzameling validatiemonsters moeten dus de meest voorkomende matrices vertegenwoordigd zijn, op basis van inzicht in de relatieve aandelen van de verschillende monsters in de monsterstroom van het laboratorium. Eventueel kan de monsterselectie toegespitst worden op de “moeilijkste” matrix, rekening houdend met de onder punt 3.2 beschreven beperkingen.

Intra-reproduceerbaarheid, herhaalbaarheid, selectiviteit en robuustheid worden in principe bepaald op praktijkmonsters of monsters die hierop zoveel mogelijk gelijk zijn (bijv. geaddeerde praktijkmonsters).

Voor validatie van de aantoonbaarheids- en bepalingsgrens gebruikt men, in volgorde van voorkeur, een praktijkmonster of representatief referentiemateriaal met gehalte nabij de verwachte aantoonbaarheidsgrens, een blanco praktijkmonster waaraan de te bepalen componenten werden geaddeerd tot een gehalte nabij de verwachte aantoonbaarheidsgrens, of een blanco praktijkmonster.

Voor validatie van de juistheid gebruikt men, in volgorde van voorkeur maar steeds de gelijkenis met praktijkmonsters voor ogen houdend:

- gecertificeerd referentiemateriaal en deelname aan interlaboratoriumtesten met herleidbare referentiewaarden, dit wil zeggen waarden gerelateerd aan een geschikte (bij voorkeur internationale) meetstandaard;
- geaddeerde praktijkmonsters waarvan de werkelijke waarde gebaseerd is op de gravimetrisch/volumetrisch toegevoegde hoeveelheid, deze kunnen zowel zelf aangemaakt zijn of deel uitmaken van een 'proficiency testing'; hierbij dient opgemerkt te worden dat additie-experimenten te optimistische resultaten kunnen opleveren omdat het toegevoegde deel van de component niet op dezelfde wijze in het monster opgenomen wordt als het oorspronkelijke deel;
- rondzendmonsters met een consensuswaarde (bijv. gemiddelde waarde uit 'proficiency testing' schema's) waarbij verschillende/gelijke methoden werden toegepast;
- niet-gecertificeerd referentiemateriaal en/of praktijkmonsters met een waarde die onafhankelijk is van het te valideren systeem, bijvoorbeeld bepaald met een andere methode waarvan de bias gekend is.

Voor de bepaling van de bias ten opzichte van een methodegemiddelde kan een gecertificeerd referentiemateriaal of een rondzendmonster met een consensuswaarde (bijvoorbeeld gemiddelde waarde uit ringtest) worden gebruikt, mits voor de berekening van de gecertificeerde waarde of consensuswaarde enkel meetresultaten, bekomen met dezelfde methode, werden verwerkt. Deze consensuswaarde kan verschillen van de werkelijke waarde.

Voor evaluatie van de lineariteit gebruikt men dezelfde matrix als bij de kalibratie (dit is meestal standaardoplossing, doch bij sommige technieken ook monster).

4 ALGEMENE PROCEDURE VOOR DE BEPALING VAN DE AFZONDERLIJKE PRESTATIEKENMERKEN

4.1 JUISTHEID

Hieronder worden eerst twee klassieke werkwijzen behandeld, nl. meervoudige analyse van een referentiemateriaal (met gekende ware waarde) en uitvoering van terugvindingsexperimenten op een geselecteerd monster.

Indien de juistheid slechts bij één concentratieniveau gevalideerd wordt, ligt dit bij voorkeur nabij de kritische waarde volgens de regelgeving, in het gebied tussen de typische waarden voor praktijkmonsters en deze kritische waarde. Bij onderzoek op meer dan één concentratieniveau (wat overigens aanbevolen wordt door Eurachem) kiest men deze tenminste een factor 10 uit elkaar.

Verder wordt een alternatieve werkwijze beschreven, namelijk evaluatie van de terugvinding en/of afwijking ten opzichte van de referentiewaarde voor verschillende monsters. Hierbij kan niet enkel de terugvinding van addities op verschillende monsters en/of verschillende concentratieniveau's gebruikt worden, maar eveneens resultaten bekomen via deelname aan 'proficiency testing' schema's (interlaboratoriumtesten), vergelijkende resultaten t.o.v. een referentiemethode, Deze werkwijze is vooral aangewezen indien er twijfel bestaat over het effect van diverse matrices binnen het toepassingsgebied (of desgevallend deelgebied) op de prestatiekenmerken juistheid en/of selectiviteit (matrixeffect).

Elk van de klassieke werkwijzen levert, naast informatie over de juistheid, simultaan informatie over de intra-reproduceerbaarheid van de analysemethode.

4.1.1 MEERVOUDIGE ANALYSE VAN EEN REFERENTIEMATERIAAL

Indien voor het toepassingsgebied (of desgevallend een deelgebied) een monster met een ware waarde of consensuswaarde beschikbaar is, voer dan hierop minstens 5 analyses (cfr. punt 2.12) uit, onder intra-reproduceerbaarheidsomstandigheden (op verschillende dagen, met weerspiegeling van typische laboratoriumomstandigheden qua uitvoerende analisten, kalibratie, ...). Bereken het gemiddelde van de bekomen meetwaarden. De bias wordt gegeven door:

$$b_{c(\text{rel})} = \frac{X_{\text{gem}} - C_{\text{ref}}}{C_{\text{ref}}} \times 100(\%) \quad (\text{in geval van een proportionele bias als } \%),$$

of

$$b_{c(\text{abs})} = X_{\text{gem}} - C_{\text{ref}} \quad (\text{in geval van een constante absolute bias}),$$

met:

$b_{c(\text{rel})}$	procentuele bias (bij een waarde c van de meetgrootheid)
$b_{c(\text{abs})}$	absolute bias (bij een waarde c van de meetgrootheid)
X_{gem}	gemiddelde waarde van de meetgrootheid
C_{ref}	ware waarde van het referentiemateriaal

De juistheid (uitgedrukt in %) wordt dan gegeven door $(100 + b_{c(\text{rel})})$.

De situatie van een constante absolute bias kan zich ondermeer voordoen in een laag concentratiegebied, bij een constante ongekende interferentie.

Indien binnen een bepaald toepassingsgebied op verschillende referentiematerialen dergelijke meervoudige analyse is uitgevoerd, wordt de juistheid bij voorkeur berekend door uit te middelen over de geanalyseerde afvalstoffen. Hierbij dient de zin van de afwijking (+ of -) mee in rekening te worden gebracht en dient desgevallend onderscheid gemaakt te worden tussen de situaties proportionele of constante absolute bias.

4.1.2 TERUGVINDINGSEXPERIMENTEN OP EEN GESELECTEERD MONSTER

Indien geen geschikt monster met een ware waarde of consensuswaarde beschikbaar is en de component op een representatieve manier aan het monster kan toegevoegd worden, is een terugvindingsexperiment de meest aangewezen benadering. Een nadeel hiervan is dat bepaalde systematische afwijkingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door interferenties, niet kunnen worden vastgesteld.

Neem hiervoor minstens 10 deelmonsters (cfr. Punt 2.12) en voeg aan de helft een bekende hoeveelheid van de component zo representatief mogelijk toe, waardoor de meetgrootheid met Δc wordt verhoogd. Richtlijnen met betrekking tot de werkwijze voor additie worden gegeven in bijlage B.

Bepaal per monster de terugvinding uit het analyseresultaat voor het monster zonder en het monster met toevoeging van de component. Voer beide metingen zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden uit, dit wil zeggen in dezelfde analysereeks. Voer minstens 5 dergelijke paren analyses onder intra-reproduceerbaarheidsomstandigheden uit (dit wil zeggen elk paar op een andere dag, met weerspiegeling van typische laboratoriumomstandigheden qua uitvoerende analisten, kalibratie, ...).

Bereken voor elk van de experimenten de terugvinding (uitgedrukt in %) als:

$$T_{\Delta c,i} = \frac{X_{c+\Delta c,i} - X_{c,i}}{\Delta c} \times 100(\%)$$

met:

$T_{\Delta c,i}$	procentuele terugvinding bij het i-de experiment (bij toevoeging Δc van de meetgrootte)
$X_{c+\Delta c,i}$	i-de analyseresultaat voor waarde c met additie Δc van de meetgrootte
$X_{c,i}$	i-de analyseresultaat voor waarde c van de meetgrootte
Δc	geaddeerde waarde van de meetgrootte

Bereken van de aldus bekomen terugvindingen de gemiddelde waarde $\bar{T}$, welke een maat is voor de juistheid, uitgedrukt in %. De procentuele bias kan berekend worden uit $b_{c\,rel} = \bar{T} - 100$.

4.1.3 EVALUATIE VAN DE TERUGVINDING EN/OF AFWIJKING TEN OPZICHTE VAN DE REFERENTIEWAARDE VOOR VERSCHILLENDE MONSTERS

Voor wat addities betreft, gelden bij deze methode dezelfde randvoorwaarden en beperkingen als beschreven onder punt 4.1.2.

Voeg aan een deelmonster van een reeds eerder geanalyseerd monster een bekende hoeveelheid van de component zo representatief mogelijk toe, waardoor de meetgrootte met Δc wordt verhoogd. Analyseer dit monster met additie in dezelfde meetreeks, zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden als het oorspronkelijk monster. Voer in totaal 5-10 dergelijke terugvindingsanalyses uit op verschillende monsters en concentratieniveaus, er over wakend dat deze als geheel de praktijksituatie zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Voer de verschillende analyses op monsters met additie onder intra-reproduceerbaarheidsomstandigheden uit (op verschillende dagen, met weerspiegeling van typische laboratoriumomstandigheden qua uitvoerende analisten, kalibratie, ...).

Bereken voor elk van de minstens 5 experimenten de terugvinding (uitgedrukt in %) uit het analyseresultaat voor het monster zonder en het monster met toevoeging van de component (voor formule zie punt 4.1.2). Bereken van de aldus bekomen terugvindingen de gemiddelde waarde. De procentuele bias kan berekend worden uit $b_{c\,rel} = \bar{T} - 100$.

Bij deze werkwijze kunnen, naast terugvindingen bekomen via een additie-experiment, eveneens terugvindingen afgeleid uit de deelname aan 'proficiency testing' schema's, uit vergelijking van de methode t.o.v. een referentiemethode, ..., gebruikt worden. Hierbij blijft het belangrijkste uitgangspunt het gebruik van verschillende monsters, waarbij deze qua matrix en concentratieniveau het toepassingsgebied zo goed mogelijk moeten dekken.

4.2 HERHAALBAARHEID EN INTRA-REPRODUCEERBAARHEID

De algemene procedure voor het bepalen van de prestatiekenmerken herhaalbaarheid en intra-reproduceerbaarheid is dezelfde, met uitzondering van de analysecondities bij de experimenten (cfr. punt 2.3 en 2.4). Voor intra-reproduceerbaarheid wordt minstens de factor tijd bijkomend gevarieerd (uitvoering van de herhalingsanalyses op verschillende dagen) en voor zover relevant ook andere bronnen van variatie (analist, apparaat, kalibratie, ...). De bedoeling is om een zo goed mogelijke afspiegeling van de praktijksituatie te bekomen.

Er zijn twee klassieke werkwijzen, namelijk herhaalde analyse van hetzelfde monster en duplo-analyse van verschillende monsters (zie punt 4.2.1 en 4.2.2). Eerstgenoemde benadering heeft als nadeel dat de informatie *sensu strictu* beperkt blijft tot dat ene monster. Anderzijds geldt bij laatstgenoemde benadering in principe de beperkende voorwaarde dat óf de standaardafwijking óf de variatiecoëfficiënt niet mag afhangen van de waarde van de meetgrootte, wat vaak eveneens tot een klein meetbereik leidt.

Indien, volgens eerstgenoemde werkwijze, de precisie slechts bij één concentratieniveau gevalideerd wordt, ligt dit bij voorkeur nabij de kritische waarde volgens de regelgeving, in het gebied tussen de typische waarden voor praktijkmonsters en deze kritische waarde. Bij onderzoek op meer dan één concentratieniveau (wat overigens voor herhaalbaarheidsonderzoek aanbevolen wordt door Eurachem) kiest men deze tenminste een factor 10 uit elkaar.

In praktijk zal een analysemethode, na ingebruikname, meestal ook opgevolgd worden aan de hand van een relevant controlemonster, zodat voor periodieke herevaluatie van de intra-reproduceerbaarheid ook de resultaten van deze eerstelijnscontrole als input gebruikt kunnen worden.

4.2.1 MEERVOUDIGE ANALYSE VAN HETZELFDE MONSTER

Voer op een volgens de aanbevelingen in punt 3.4 gekozen monster, desgevallend per deelgebied, minstens 5 analyses (cfr. punt 2.12) uit onder herhaalbaarheidscondities, respectievelijk intra-reproduceerbaarheidscondities. Bereken hieruit de herhaalbaarheidsstandaardafwijking s_r , respectievelijk intra-reproduceerbaarheidsstandaardafwijking s_R , als:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

s = standaardafwijking, in eenheid analyseresultaat

n = aantal analyses, $n \geq 5$

x_i = i -de analyseresultaat

$\bar{x}$ = gemiddelde van n analyseresultaten

Bij gebrek aan een geschikt monster kan eventueel gebruik gemaakt worden van een praktijkmonster waaraan een gepaste hoeveelheid van de component is geaddedeerd, dit voor zover de geaddedeerde component zoveel mogelijk op dezelfde wijze in het monster opgenomen is als de component van het praktijkmonster. Voor richtlijnen met betrekking tot additie wordt verwezen naar bijlage B.

4.2.2 DUPLO-ANALYSE VAN VERSCHILLENDE MONSTERS

Kies de grootte van het (deel)gebied zo dat redelijkerwijs mag worden verondersteld dat óf de standaardafwijking óf de variatiecoëfficiënt van de analyseresultaten niet afhangt van de waarde van de meetgrootte. Veelal neigt de spreiding ruim boven de aantoonbaarheidsgrens naar proportionaliteit en mag in dit deel van het werkgebied de variatiecoëfficiënt constant verondersteld worden. Nabij de aantoonbaarheidsgrens mag daarentegen de standaardafwijking veelal constant verondersteld worden (cfr. punt 2.10).

Gebruik monsters volgens de aanbevelingen in punt 3.4. Analyseer (cfr. punt 2.12), desgevallend per deelgebied, minstens 5 verschillende monsters in duplo. Bij het herhaalbaarheidsonderzoek dienen beide analyses van een paar onder herhaalbaarheidscondities uitgevoerd te worden. De verschillende monsters worden wel bij voorkeur op verschillende dagen geanalyseerd. Bij het intra-reproduceerbaarheidsonderzoek mogen beide analyses van een paar niet op dezelfde dag uitgevoerd worden en dient het geheel gespreid te worden over tenminste evenveel dagen als het aantal monsterparen.

Als voor het betreffende meetbereik de standaardafwijking onafhankelijk mag worden verondersteld van de waarde van de meetgrootte (homogeniteit van de varianties), dan mogen de n standaardafwijkingen uit duplo's worden samengevoegd en kan s_r , resp. s_R , berekend worden als (ontwerp NEN 7777: 2001; AP 04 SG: 1998):

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - x_{i2})^2}{2n}}$$

s = standaardafwijking, in eenheid analyseresultaat
 n = aantal monsters in duplo geanalyseerd, $n \geq 5$
 x_{i1} = eerste analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i
 x_{i2} = tweede analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i

Als voor het betreffende meetbereik de variatiecoëfficiënt onafhankelijk mag worden verondersteld van de waarde van de meetgrootte, dan mogen de n variatiecoëfficiënten uit duplo's worden samengevoegd en kan de variatiecoëfficiënt CV_r , resp. CV_R , worden berekend uit de genormaliseerde verschillen als (ontwerp NEN 7777: 2001; AP 04 SG: 1998):

$$CV = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_{i1} - x_{i2}}{0.5(x_{i1} + x_{i2})} \right)^2}{2n}} \times 100(\%)$$

CV = variatiecoëfficiënt, in %
 n = aantal monsters in duplo geanalyseerd, $n \geq 5$
 x_{i1} = eerste analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i
 x_{i2} = tweede analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i

4.3 SELECTIVITEIT EN ROBUUSTHEID

Afzonderlijke selectiviteitsproeven zijn enkel zinvol in die gevallen waarbij de invloed onvoldoende wordt afgedekt door een ander prestatiekenmerk zoals juistheid. Experimenten hieromtrent situeren zich vaak eerder in het ontwikkelingsstadium van een analysemethode dan in het validatiestadium.

Kies om het effect van een bepaalde invloedsgrrootte te onderzoeken zo mogelijk een praktijkmonster, volgens de aanbevelingen in punt 3.4. Voeg aan verschillende deelmonsters een telkens toenemende hoeveelheid van de invloedsgrrootte toe, zo representatief mogelijk en met minimale verdunning als gevolg. Analyseer de aldus bekomen monsters onder herhaalbaarheidscondities en bepaal de verandering van het analyseresultaat als gevolg van een verandering van de waarde van de invloedsgrrootte. Al naargelang de voorkennis kan het noodzakelijk zijn om bovenvermelde proef uit te voeren in het onderste en bovenste deel van het werkgebied.

In geval er geen enkele voorkennis is met betrekking tot interferenten en er geen referentiematerialen beschikbaar zijn, kan de selectiviteit als volgt onderzocht worden:

- het analyseren van praktijkmonsters met de betreffende analysemethode en met een andere onafhankelijke analyse- of meetmethode (ander scheidings- en/of detectieprincipe);
- het analyseren van opeenvolgende, steeds grotere, verdunningen van praktijkmonsters (op voorwaarde dat de te bepalen component in voldoende hoge concentratie aanwezig is om nog in verdunning gemeten te kunnen worden).

Robuustheid is impliciet begrepen in de intra-reproduceerbaarheid, en zal meestal evenmin een specifieke validatie behoeven. De verhouding tussen intra-reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid kan worden gehanteerd als een maat voor (het gebrek aan) robuustheid. In het ideale geval zou deze verhouding 1 moeten bedragen, maar in praktijk zijn verhoudingen tot 1.5 tot 2 niet ongewoon.

Eventuele specifieke experimenten, gericht op de verandering van het analyseresultaat als gevolg van een verandering van de uitvoeringsomstandigheden, kunnen op gelijkaardige wijze opgezet worden als hierboven beschreven voor selectiviteitsonderzoek. Meestal zal het programma voor eerstelijns kwaliteitscontrole zodanig ontworpen worden dat de meest kritische variabelen, namelijk de variabelen met het grootste effect op de juistheid en precisie, expliciet gecontroleerd worden.

4.4 AANTOONBAARHEIDSGRENS EN BEPALINGSGRENS

In deze procedure wordt de aantoonbaarheidsgrens (AG) geoperationaliseerd als 3 maal de standaardafwijking op laag niveau (cfr. punt 2.7) en dit onder intra-reproduceerbaarheidscondities.

Hieronder worden twee benaderingen beschreven, nl. meervoudige analyse van een praktijkmonster met gehalte nabij de aantoonbaarheidsgrens en duplo-analyse van verschillende praktijkmonsters met gehalte nabij de aantoonbaarheidsgrens.

Eerstgenoemde werkwijze is de meest klassieke maar heeft als nadeel dat de onzekerheid die het gevolg is van de aanwezigheid van interferenten in monsters, verschillende matrixeffecten en dergelijke niet gedekt wordt. Daarom kan de eigenlijke aantoonbaarheidsgrens onder praktijkomstandigheden hoger zijn. Deze beperking wordt enigszins ondervangen door de tweede werkwijze.

Met de term 'gehalte nabij de aantoonbaarheidsgrens' (of 'laag gehalte') wordt een gehalte bedoeld dat bij voorkeur in het bereik tussen ca. 1 en 5 maal de aantoonbaarheidsgrens ligt en dat niet meer dan 10 maal de aantoonbaarheidsgrens bedraagt. Indien een parametergroep een groot aantal componenten (bijvoorbeeld >10) bevat kan het praktisch moeilijk zijn om een monster te vinden dat voor elke component ideaal is. In dergelijk geval mag voor enkele componenten van bovenvermelde beperking qua concentratiebereik afgeweken worden of mag de aantoonbaarheidsgrens geëxtrapoleerd worden uit soortgelijke componenten.

4.4.1 MEERVOUDIGE ANALYSE VAN EEN PRAKTIJKMONSTER MET LAAG GEHALTE

Gebruik hiervoor een monster volgens de aanbevelingen in punt 3.4. Analyseer het monster strikt volgens de gebruikelijke analyseprocedure (cfr. Punt 2.12). Analyseer het monster na één of meerdere dagen opnieuw, en vervolg dit totdat tenminste 5 analyseresultaten zijn verkregen. Voer de proeven zo uit dat het geheel de praktijksituatie (qua uitvoerende analisten, omgevingsomstandigheden, volgnummer in reeks, ...) weerspiegelt.

Bereken de standaardafwijking s_R uit de analyseresultaten en hieruit de aantoonbaarheidsgrens $AG_R = 3 s_R$.

Verhoog de waarde van de aantoonbaarheidsgrens met de gemiddelde waarde van de procedureblanco indien deze meetbaar is en een correctie voor de procedureblanco geen deel uitmaakt van de gebruikelijke analyseprocedure.

Wanneer verschillende praktijkmonsters met laag gehalte meervoudig geanalyseerd werden, wordt de hoogste van de bekomen waarden als uiteindelijke maat voor de aantoonbaarheidsgrens en bepalingsgrens, gehanteerd.

4.4.2 DUPLO-ANALYSE VAN VERSCHILLENDE PRAKTIJKMONSTERS MET LAAG GEHALTE

Gebruik monsters volgens de aanbevelingen in punt 3.4. Analyseer (cfr. punt 2.12) minstens 5 verschillende monsters in duplo, voer beide analyses van een paar niet op dezelfde dag uit en spreid het geheel over tenminste evenveel dagen als het aantal monsterparen.

Bereken s_R als (cfr. punt 4.2.2):

$$s_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - x_{i2})^2}{2n}}$$

s_R = intra-reproduceerbaarheidsstandaardafwijking, in eenheid analyseresultaat
 n = aantal monsters in duplo geanalyseerd, $n \geq 5$
 x_{i1} = eerste analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i
 x_{i2} = tweede analyseresultaat van een duplo-analyse op monster i

Bereken hieruit de aantoonbaarheidsgrens $AG_R = 3 s_R$.

Verhoog de waarde van de aantoonbaarheidsgrens met de gemiddelde waarde van de procedureblanco indien een correctie voor de procedureblanco geen deel uitmaakt van de gebruikelijke analyseprocedure.

4.5 LINEARITEIT - MODELAFWIJKING

Bij de bepaling van de alineariteit, of meer algemeen de modelafwijking ('lack-of-fit'), wordt de experimentele afwijking ten opzichte van het kalibratiemodel gekwantificeerd. Veelal betreft deze enkel het instrumentele gedeelte van de analyse. Hiervoor kunnen in praktijk de experimentele meetwaarden van een kalibratie gebruikt worden.

Leg het kalibratiemodel vast aan de hand van tenminste 6 verschillende concentratieniveau's, gespreid over het gehele werkgebied. Aanbevolen wordt om bij het validatieonderzoek eenmalig elk concentratieniveau in drievoud te meten, zodat kan nagegaan worden hoe de variantie van herhalingsmetingen varieert met de concentratie.

Voer op de bekomen resultaten een gepaste regressie-analyse uit. Indien er een proportioneel verband is tussen de variantie van herhalingsmetingen en de concentratie wordt best een gewogen regressie toegepast. Het louter gebruiken van een correlatiecoëfficiënt ter bepaling van de lineariteit wordt afgeraden omdat dit een maat is voor de correlatie, niet voor de lineariteit. Het weerhouden kalibratiemodel moet uiteraard ook gehanteerd worden bij de verdere praktijktoepassing van de analysemethode.

Bereken de modelafwijking voor een waarde c van de meetgrootheid als:

$$\delta_{c, \text{model}} = X_{c, \text{exp}} - X_{c, \text{model}}$$

met:

$X_{c, \text{exp}}$ experimentele meetwaarde of desgevallend de gemiddelde waarde van de herhalingsmetingen bij een waarde c van de meetgrootheid

$X_{c, \text{model}}$ berekende meetwaarde welke volgens het kalibratiemodel bekomen wordt voor een waarde c van de meetgrootheid

Zet de modelafwijkingen grafisch uit in functie van de meetgrootheid en verifieer of deze random verdeeld zijn, systematische trends wijzen op non-lineariteit. Grote procentuele afwijkingen zijn niet noodzakelijk een indicatie voor alineariteit, maar verdienen niettemin speciale aandacht omdat ze tot een slechte intra-reproduceerbaarheid en hoge meetonzekerheid kunnen leiden. Alternatief kan men de responsfactoren $RF_c = X_c / c$ (of relatieve responsfactoren, bij gebruik van een interne standaard) uitzetten en toetsen ten opzichte van een vastgelegde eis. Meestal houdt zulke eis rekening met de aard van de bepalingmethode.

Een tweede mogelijkheid is de kalibratiegegevens enerzijds met een lineair model en anderzijds met een kwadratisch model te evalueren (ISO 8466-1, 1990). Uit beide modellen wordt de residuele standaardafwijking s_{y1} en s_{y2} verkregen. Het verschil van de varianties DS^2 wordt als volgt berekend:

$$DS^2 = (N-2)s_{y1}^2 - (N-3)s_{y2}^2$$

met:

N het aantal concentratieniveaus ($N \geq 6$)

s_{y1}^2 residuele standaardafwijking bij lineair model

s_{y2}^2 residuele standaardafwijking bij kwadratisch model

het aantal vrijheidsgraden f is 1.

Vervolgens worden DS^2 en de variantie van de kwadratische kalibratiefunctie aan een F-test onderworpen om na te gaan of er significante verschillen bestaan. De testwaarde, F_{ber} , wordt bekomen uit:

$$F_{ber} = \frac{DS^2}{s_{y2}^2}$$

Indien $F_{ber} \leq F_{tabel}$, dan leidt de kwadratische functie niet tot een significant beter model, met andere woorden is de kalibratiefunctie lineair.

Indien $F_{ber} > F_{tabel}$, dan wordt het werkgebied verkleind om een lineaire kalibratiefunctie te verkrijgen, ofwel worden de meetwaarden van monsters met de kwadratische functie geëvalueerd.

Een derde mogelijkheid, weliswaar minder fundamenteel, is de berekening van een kwadratische functie, waarna gebruik gemaakt wordt van een t-test om te beoordelen of de coëfficiënt van de kwadratische term significant afwijkt van 0.

Bij vaststelling van een niet-lineair verband wordt aanbevolen om na te gaan hoe relevant het verschil is tussen een resultaat bekomen met een lineaire functie en met een kwadratische functie. Indien dit klein is vergeleken met de meetonzekerheid kan overwogen worden om toch met de

lineaire vergelijking door te gaan en de corresponderende fout mee te verrekenen in de globale meetonzekerheid.

Voor de praktische uitwerking wordt verwezen naar de voorbeelden in CMA/6/C.

4.6 WERKGEBIED

De ondergrens van het werkgebied van een kwantitatieve analysemethode ligt in principe op of boven de bepalingsgrens en binnen het gebied waarvoor de lineariteit werd aangetoond.

Als vuistregel (streefwaarde) wordt in het kader van deze procedure vooropgesteld dat de rapportagegrens, de waarde beneden welke een component als niet kwantificeerbaar ('<') wordt gerapporteerd, hoogstens een vijfde van de toetsingswaarde of normwaarde voor de gemeten monsters bedraagt, tenzij niet haalbaar volgens de huidige stand der techniek². Dit geldt zowel in geval de bepalingsgrens als rapportagegrens fungeert, als in geval van het systematisch gebruik van een rapportagegrens die hoger ligt dan de bepalingsgrens.

Wanneer het snijpunt van de kalibratielijn met de Y-as niet significant verschillend is van nul kan het werkgebied uitgebreid worden tot onder het concentratieniveau van de laagste kalibratiestandaard en tot de bepalingsgrens. In het andere geval wordt aanbevolen de laagste kalibratiestandaard als ondergrens van het werkgebied te beschouwen.

In bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn om ook waarden tussen de aantoonbaarheidsgrens en de bepalingsgrens te rapporteren, omdat er wel degelijk informatie in zulke waarden kan zitten zodra over een aantal uitslagen wordt uitgemiddeld. Dergelijke werkwijze dient duidelijk te blijken uit het analyseverslag, bijvoorbeeld door de vermelding van de meetwaarden samen met de bepalingsgrens. Met betrekking tot de in eerste alinea beschreven vuistregel is het onverminderd de bepalingsgrens die aan het criterium moet getoetst worden.

In de meeste gevallen is het werkgebied tot boven het lineaire gebied uit te breiden door verdunning van het monster of door minder monster in bewerking te nemen. Beperkende factoren voor de bovengrens zijn mogelijk, al naargelang de analysemethode, het optreden van geheugeneffecten, de capaciteit van bepaalde voorbereidingsstappen, ...

5 EISEN INZAKE VALIDATIE VAN DE ANALYSEPAKKETTEN VOOR AFVALSTOFFEN EN BODEM

Vooraleer nader in te gaan op minimale eisen, wordt het algemeen kader van de erkenning geschetst. Het uitgangspunt van de erkenningen is totaal verschillend van deze bij de accreditatie. Nochtans vormt de ISO 17025 enerzijds de basis voor de accreditatie van een laboratorium maar dient de norm tegelijk ook toegepast te worden voor de erkenning als laboratorium door de OVAM.

Het instrument 'erkenningen laboratoria' werd door de Vlaamse regering ingevoerd voor het verrichten van analyses op o.a. afvalstoffen en zij bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de erkenning. In VLARELbis wordt het toepassingsgebied van de erkenning laboratoria voor de analyses

² In voorkomend geval wordt dit in de betreffende CMA-procedure en/of in een rapport van OVAM of het referentielaboratorium duidelijk aangegeven.

op afvalstoffen en bodem opgesomd. Verschillende Vlaamse milieuwetgevingen vermelden specifieke normen voor bepaalde parameters afhankelijk van het beoogde doel, hetzij als afvalstof (storten, verbranden, hetzij als grondstof (bodemverbeterend middel, bouwstof, bodem) thermisch behandelen dierlijk afval, controle op gevaarseigenschappen) hetzij als bodem (saneren, gebruik als bodem, bouwkundig bodemgebruik). De voormelde normenkaders groeperen dus verschillende parameters die weerspiegeld worden in analysepakketten. Bijlage A bevat de volledige lijst van de pakketten waarvoor laboratoria kunnen erkend worden, vastgelegd door VLARELbis.

Voor afvalstoffen bestaan er zeer veel verschillende monstertypes zodat het onbegonnen werk is om de parameters van de normenkaders in alle afvalstoftypes te valideren. OVAM besliste om een sterk beperkt aantal relevante monstertypes over te houden per hoofdmatrix. Afhankelijk van de milieuwetgeving kunnen voor elk analysepakket 1 of meer hoofdmatrices aangeboden worden met binnen elke hoofdmatrix 1 of meer submatrices of monstertypes. (cfr Bijlage B).

Voor een aantal laboratoria zullen de opgesomde monstertypes niet overeenstemmen met hun courant monsteraanbod. Vanuit het oogpunt van staalaanbod voor erkenningsaanvraag en kwaliteitsopvolging (3^{de} lijnscontrole) is het echter niet mogelijk om met de beschikbare financiële middelen de erkenning voor analysepakketten nog verder uit te splitsen naar welbepaalde monstertypes en tegelijk aan de wettelijke bepalingen (jaarlijks aanbod en controle) te blijven voldoen. Om voormelde redenen wordt geen verdere beperking van het aantal hoofdmatrices per analysepakket toegestaan.

Omwille van voormelde randvoorwaarden zijn in de analysepakketten bepaalde parameter(s) slechts relevant voor specifieke hoofdmatrix of monstertype. Het is dan ook logisch dat de prestatiekenmerken slechts moeten afgeleid worden voor de relevante monstertypes. Bovendien kan de destructie- of analysemethode nog verschillen afhankelijk van het monstertype. OVAM verduidelijkte de eisen inzake methodevalidatie en de te volgen analysemethode voor bepaalde parameters in monstertypes. Ook nadien zijn nog aanvullingen meegedeeld. Alle verdere verfijningen per analysepakket worden gegroepeerd in Bijlage B.

De validatie gebeurt per hoofdmatrix waarbij alle relevante submatrices als monstertype worden meegenomen. Bij voorkeur selecteert het laboratorium voor een bepaald analysepakket per hoofdmatrix uit de opgesomde monstertypes minstens 5 monsters met verschillende aard/herkomst die overeenstemmen met het werkelijke monsteraanbod.

Op deze 5 reële monsters wordt de intrareproduceerbaarheid bepaald via duplo-analyses (met aparte voorbehandeling). Indien voormelde selectie niet mogelijk is, moet het laboratorium uit de opgesomde monstertypes minstens 2 reële monsters met verschillende aard/herkomst selecteren. Op elk monster wordt de analyse minstens in 5-voud uitgevoerd voor de bepaling van intrareproduceerbaarheid.

De aantoonbaarheidsgrens wordt op analoge wijze bepaald, doch met monsters met een hiervoor geschikt gehalte.

Indien de analysemethode voor een submatrix verschillend is ten opzichte van de analysemethode voor de andere submatrices of indien de prestatiekenmerken voor parameter(s) in een submatrix afwijken van deze in de andere submatrices, is een aparte validatie voor de submatrix noodzakelijk.

6 REFERENTIES

- Anal. Chim. Acta (1997), Hartmann et al., nr 338, p. 19-40.
- AOAC Peer Verified Methods Program – Manual on Policies and Procedures, AOAC International, Arlington VA 22201-3301, USA.

- AP 04 SG (1998), 'Accreditatieprogramma bouwstoffenbesluit, onderdeel: samenstelling grond', versie 4, juni 1998.
- EA 2/06 (1997), 'Validation of test methods - General principles and concepts' februari 1997.
- EPA (1982), 'Definition and procedure for the determination of the method detection limit', juli 1982.
- Eurachem (1998), 'The fitness for purpose of analytical methods - A laboratory guide to method validation and related topics', versie 1.0.
- Eurachem/CITAC (2000), 'Quantifying uncertainty in analytical measurement'.
- IUPAC (1995), Nomenclature in Evaluation of Analytical Methods, Including Detection and Quantification Capabilities, IUPAC Recommendations 1995, Pure and Appl. Chem., 1995, 67, 1699 – 1723.
- ISO 3534-1 (1993), 'Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: Probability and general statistical terms'.
- ISO 5725-1 to -6 (1994), 'Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results'.
- ISO 8466-1 (1990), 'Water quality – Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics: Part 1 – Statistical evaluation of the linear calibration function', 1st Edition 1990 (E).
- ISO 9169 (1994), 'Air quality - Determination of performance characteristics of measurement methods'.
- ISO GUM / NBN X40-001 (1995), 'Guide to the expression of uncertainty in measurement'
- NBN-ISO 8402 (1990), 'Kwaliteit: Termen en definities'.
- Ontwerp NEN 7777 (2001), 'Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden', november 2001.
- Pharmaceutisch Weekblad (1992), 'Richtlijnen voor analytische validatie', van de Vaart, nr. 46, p. 1229-1235.
- RIVM (1994), 'Prestatiekenmerken voor meetmethoden. Termen, definities en testprocedures ten behoeve van het Accreditatieprogramma Normalisatie en Validatie van Milieumeetmethoden', van de Wiel et al., Rapportnr. 219101004.
- RvA SC08 (1996), 'Aanvullende criteria voor methode-validatie'.

BIJLAGE A PAKKETTEN WAARVOOR LABORATORIA KUNNEN ERKEND WORDEN

- MA** Monsternemingen van afvalstoffen en andere materialen en monstervoorbehandeling ter plaatse
- MA.2** gebruik als meststof/bodemverbeterend middel
- MA.3** gebruik als bouwstof-vaste stoffen
- MA.4** verbranden
- MA.5** storten
- MA.6** eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval
- MA.7** asbest
- MA.7.1** asbest in hopen
- MA.7.2** asbest in lagen

A.2 gebruik als meststof/bodemverbeterend middel**A.2.1 gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – anorganische parameters:**

zuurtegraad, droogrest/vocht, organische stof, totale stikstof, difosforpentoxide, nitraatstikstof en ammoniakale stikstof, geleidbaarheid

metalen (totaalconcentratie): arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink

A.2.2 gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – organische parameters:

chloorkoolwaterstoffen : som van 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen en 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen, 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): naftaleen, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antracene, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, acenaftaleen, acenaftyleen, antracene, dibenzo(a,h)antracene, fluoreen, pyreen

minerale olie: fractie C10-C20 en fractie C20-C40

polychloorbifenylen (PCB): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

A.2.3 gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – specifieke parameters:

steentjes, groter dan 5 mm

graad van verontreiniging (glas, metaal, kunststoffen) groter dan 2 mm

kiemkrachtige zaden

rijpheidsgraad

stabiliteit met gesloten respirometer

A.2.4 PFAS in meststof/bodemverbeterend middel

Dit pakket is een uitbreiding van het volledige pakket A.2.2.

perfluor-nbutaan zuur (PFBA)

perfluor-n-pentaa zuur (PFPeA)

perfluor-n-hexaa zuur (PFHxA)

perfluor-n-heptaa zuur (PFHpA)

perfluor-n-octaanzuur (PFOA)
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (MePFOSA)
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP)
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur (MePFBSAA)
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (EtPFOSA)
N-methylperfluor-n-octaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA)
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamidoazijnzuur (EtPFOSAA)
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)
perfluor-n-trisdecaansulfonzuur (PFTrDS)

A.3 gebruik als bouwstof

A.3.1 gebruik als niet-vormgegeven bouwstof (uitdovend)

droogrest

metalen (totaalconcentratie en uitloogbare fractie via kolomtest):
arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink

BTEXS:

benzeen, toluen, ethylbenzeen, som xylenen en styreen

Alkanen:

hexaan, heptaan en octaan

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):

naftaleen, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen

minerale olie

polychloorbifenylen (PCB):

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

A.3.2 gebruik als vormgegeven bouwstof (uitdovend)

dit pakket is een uitbreiding op pakket niet-vormgegeven bouwstof A.3.1

metalen (uitloogbare fractie met maximale beschikbaarheidstest en via standtest):

arsen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink

pH, sulfaat, chloriden en calcium (via uitloging in de maximale beschikbaarheidstest en in de standtest)

geleidbaarheid (via uitloging in de standtest)

A.3.3 fysische verontreinigingen:

vlottende verontreinigingen, niet-vlottende verontreinigingen en glas

A.3.4 gebruik als bouwstof

droogrest

metalen (totaalconcentratie en uitloogbare fractie via de kolomtest): arsen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink

metalen (uitloogbare fractie via kolomtest): antimoon, barium, molybdeen, vanadium, kobalt, seleen, tin

anionen (uitloogbare fractie via de kolomtest): bromide, chloride, fluoride en sulfaat

BTEXS: benzeen, toluen, ethylbenzeen, som xylenen en styreen

alkanen: hexaan, heptaan en octaan

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): naftaleen, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, acenafteen, acenaftyleen, antraceen, dibenzo(a,h)antraceen, fluoreen en pyreen

minerale olie

polychloorbifenylen (PCB): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

cyanides: vrij cyanide, niet-chlooroxideerbare cyanides

A.3.5 PFAS in bouwstof

Dit pakket is een uitbreiding van het volledige pakket A.3.1 of A.3.4.

perfluor-n-butaanzuur (PFBA)
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)
Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)
perfluor-1-decaansulfonzuur (PFDS)
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)
N-methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA)
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA)
N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA)
N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (EtPFOSAA)
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP)
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)
N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur (MePFBSAA)

A.4 verbranden:

droogrest, vlampunt, gloeiverlies, totaal organische koolstof (TOC), calorische waarde, pentachloorfenol (PCP), benzo(a)pyreen, chloriden, fluoriden, zwavel, extraheerbare organohalogenverbindingen (EOX)

metalen (totaalconcentratie): cadmium, thallium, kwik, antimoon, arseen, lood, chroom, kobalt, koper, mangaan, nikkel, vanadium en tin

polychloorbifenylen (PCB): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180

A.5 storten

A.5.1 storten – algemene parameters:

droogrest, minerale olie met GC-FID, extraheerbare apolaire koolwaterstoffen met IR, gloeiverlies, totaal organische koolstof (TOC), totaal oplosmiddelen (aspecifiek), totaal extraheerbare organohalogeenvverbindingen (EOX), steekvastheid (afschuifspanning)

metalen (totaalconcentratie): arseen, thallium, kwik, cadmium, beryllium, barium, lood, chroom, koper, nikkel, zink, molybdeen, antimoon en seleen

vrije cyaniden

fluoriden

1-stapsschudproef met bepaling in eluaat van: pH, arseen, barium, lood, cadmium, chroom totaal, chroom VI, koper, nikkel, kwik, zink, molybdeen, antimoon, seleen, fluoride, cyanide (totaal), ammonium, nitriet, chloride, sulfaat, totaal opgeloste vaste stoffen (TDS), opgeloste organische koolstof (DOC), fenolindex

A.5.2 storten – specifieke organische parameters:

monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEXS): benzeen, toluen, ethylbenzeen, som xylenen, styreen

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): naftaleen, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, acenafteen, acenaftyleen, anthraceen, dibenzo(a,h)anthraceen, fluoreen, pyreen

polychloorbifenylen (PCB): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

A.6 microbiologische bepalingen op de eindproducten van verwerkt dierlijk afval:

Salmonella

Enterobacteriaceae

Clostridium perfringens

A.7 asbest

B.1 bodem – vaste deel

klei

organisch materiaal (TOC)

metalen (totaalconcentratie):

arsen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink

cyaniden:

vrije cyaniden, niet-chlooroxideerbare cyaniden

monocyclische aromatische koolwaterstoffen:

benzeen, toluen, ethylbenzeen, som xylene, styreen

1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen

alkanen:

hexaan, heptaan en octaan

chloorkoolwaterstoffen:

dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, vinylchloride, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, cis+trans-1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, som trichloorbenzenen, som tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen

chloorfenolen:

2-chloorfenol, 2,4-dichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol, 2,3,4,6-tetrachloorfenol, pentachloorfenol

methyltertiairbutylether

minerale olie

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):

naftaleen, acenaftyleen, acenaften, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen

pH (KCl)

B.4 asbest in bodem

Dit pakket is geen uitbreidingspakket.

B.5 waterbodem

droogrest

klei

organisch materiaal (TOC)

metalen (totaalconcentratie):

arsen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink

cyaniden:

vrije cyaniden, niet-chlooroxideerbare cyaniden

monocyclische aromatische koolwaterstoffen:

benzeen, toluen, ethylbenzeen, som xylene, styreen

alkanen:

hexaan, heptaan en octaan

minerale olie

organochloorpesticiden (OCP):

aldrin, dieldrin, chloordaan (α en γ - isomeer), DDT, DDE, DDD, hexachloorcyclohexaan (α -, β - en γ - isomeer), endosulfan (α , β en sulfaat)

polychloorbifenylen (PCB):

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):

naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen

pH (KCl)

B.6 gebruik van bodemmateriële

Dit pakket is een uitbreiding van het volledige pakket B.1 of het volledige pakket B.5.

polychloorbifenylen (PCB):

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

stenen

bodemvreemde materialen

schudtest met bepaling in eluaat van:

arsen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, pH en geleidbaarheid

B.7 storten van bodemmateriële

Dit pakket is een uitbreiding van het volledige pakket B.1 of het volledige pakket B.5.

extraheerbare apolaire koolwaterstoffen met IR

gloeiverlies

totaal oplosmiddelen (aspecifiek)

totaal extraheerbare organohalogenenverbindingen (EOX)

steekvastheid (afschuifspanning)

1-stapsschudproef (CMA/2/II/A.12) met bepaling in eluaat van:

pH, arsen, barium, lood, cadmium, chroom totaal, chroom VI, koper, nikkel, kwik, zink, molybdeen, antimoon, seleen, fluoride, cyanide, ammonium, nitriet, chloride, sulfaat, totaal opgeloste vaste stoffen (TDS), opgeloste organische koolstof (DOC), fenolindex

B.8 PFAS in bodem en waterbodem

Dit pakket is een uitbreiding van het volledige pakket B.1 of het volledige pakket B.5.

perfluor-n-butaanzuur (PFBA);

perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA);

perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA);

perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA);

perfluor-n-octaanzuur (PFOA);

perfluor-n-nonaanzuur (PFNA);

perfluor-n-decaanzuur (PFDA);

perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA);
 perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA);
 perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA);
 perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA);
 perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA);
 perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS);
 perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS);
 perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS);
 perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS);
 perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS);
 perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS);
 perfluor-1-decaansulfonzuur (PFDS);
 perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA);
 N-methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA);
 N-ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA);
 N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA);
 N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (EtPFOSAA);
 4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS);
 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS);
 8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS);
 8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP),
 hexafluorpropyleenoxidedimeerzuur (HFPO-DA);
 4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (ADONA);
 perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)

G1 grondwater

metalen (totaalconcentratie):
 arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink
 chroom VI

cyaniden:
 totaal cyaniden

monocyclische aromatische koolwaterstoffen :
 benzeen, toluen, ethylbenzeen, som xylenen, styreen
 1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen

chloorkoolwaterstoffen:
 dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, vinylchloride, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, cis+trans-1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, som trichloorbenzenen, som tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen

chloorfenolen:
 2-chloorfenol, 2,4-dichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol, 2,3,4,6-tetrachloorfenol, pentachloorfenol

methyltertiairbutylether

minerale olie

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):

naftaleen, acenaftyleen, acenaften, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen

organochloorpesticiden (OCP):

aldrin, dieldrin, chloordaan (cis+trans), DDT, DDE, DDD, hexachloorcyclohexaan (α , β en γ - isomeer), endosulfan (α , β en sulfaat)

G.2 PFAS in grondwater

Dit pakket is een uitbreiding op het volledige pakket G.1.

perfluor-n-butaanzuur (PFBA);
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA);
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA);
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA);
perfluor-n-octaanzuur (PFOA);
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA);
perfluor-n-decaanzuur (PFDA);
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA);
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDODA);
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA);
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA);
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS);
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS);
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS);
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS);
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS);
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS);
perfluor-1-decaansulfonzuur (PFDS);
perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA);
N-methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA);
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA);
N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA);
N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (EtPFOSAA);
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS);
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS);
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS);
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP);
hexafluorpropyleenoxidedimeerzuur (HFPO-DA);
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (ADONA);
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)

BIJLAGE B METHODEVALIDATIE VAN ANALYSEPAKKET MET HOOFDMATRI(X)CES EN BIJHORENDE MONSTERTYPES

B.1 Algemeen overzicht per pakket

PAKKET	HOOFDMATRIX	MONSTERTYPES
A.2. gebruik als meststof/bodemverbeterend middel	vloeibare stoffen	ruw digestaat, dunne fractie digestaat
	pasteuze stoffen	zuiveringsslib, dikke fractie digestaat
	vaste stoffen	compost, gedroogd digestaat
A.3 gebruik als bouwstof	Vaste/pasteuze stoffen	bouw- en sloopafval, as en slakken; slib van natuursteenbewerking
A.4 verbranden	olie	afgewerkte olie
	pasteuze stoffen	zuiveringsslib
	vaste stoffen	houtafval, as en slakken, shredderafval
A.5 storten	pasteuze stoffen	zuiveringsslib
	vaste stoffen	bouw- en sloopafval, shredderafval, as en slakken
A.6 eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval	pasteuze stoffen	dierlijk vet
	vaste stoffen	diermeel
A.7 asbest	vaste stoffen	granulaten
B.1 bodem – vaste deel	bodem	bodem
B.4 asbest in bodem	bodem	bodem
B.5 waterbodem	waterbodem	sediment ⁽¹⁾
B.6 gebruik van bodemmaterialen	vaste bodemmaterialen	uitgegraven bodem, vaste deel van de waterbodem
	pasteuze bodemmaterialen ⁽²⁾	sediment ⁽¹⁾
B.7 storten van bodemmaterialen	vaste bodemmaterialen	uitgegraven bodem
	pasteuze bodemmaterialen ⁽²⁾	sediment ⁽¹⁾
G.1 grondwater	water	grondwater

⁽¹⁾ Zie Figuur 1

⁽²⁾ Grondbrij en bentonietslib behoren tot de pasteuze bodemmaterialen


Voor de validatie van materialen voor gebruik als meststof/bodemverbeterend middel zijn in de 3 hoofdmatrices nog vele andere relevante monstertypes mogelijk: nl

- voor vaste stoffen – organisch-biologisch afval (OBA) met mest;
- voor pasteuze stoffen - OBA-mix en diverse organisch-biologische afvalstoffen
- voor vloeibare stoffen - effluenten na biologie, spuiroom.

De validatie moet minimaal gebeuren voor de monstertypes vermeld in de bovenstaande tabel.

Met de vermelding ‘as en slakken’ als monstertype onder de hoofdmatrix ‘vaste stoffen’ in de analysepakketten A.3, A.4 en A.5 wordt slechts één monstertype bedoeld wegens de grote gelijkenis.

Figuur 1

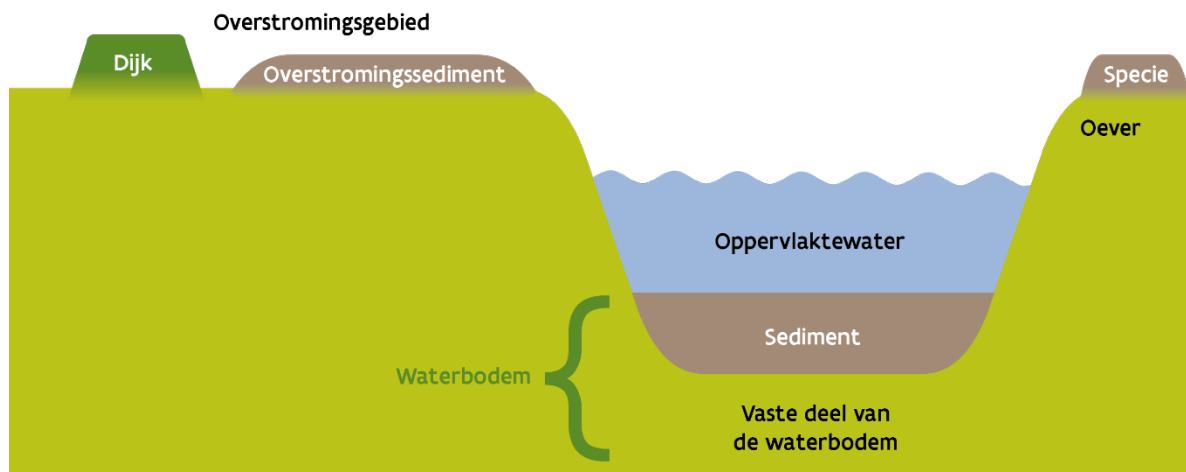

B.2 Pakket A.2

De materialen die in aanmerking kunnen komen voor het gebruik als meststof/bodemverbeterend middel (zie lijst in Vlaamse wetgeving) zijn zeer divers qua fysische aard (vloeibaar, pasteus tot vast) en qua samenstelling (gehalte aan organische stof, nutriënten). Bij de opmaak van dit pakket is het analysepakket voor compost (pakket 5) geïntegreerd vermits compost ook gebruikt wordt als meststof/bodemverbeterend middel. Het pakket A.2 is verder uitgesplitst in 3 subpakketten omwille van de sterk verschillende apparatuur en expertise voor het uitvoeren van de proeven.

De CMA-procedures voor de bepaling van de anorganische parameters in compost zijn uitgebreid naar de matrix 'Meststof/bodemverbeterend middel'. Alle methoden zijn aangepast en toepasbaar voor de bepaling van de relevante parameters in materialen die als meststof of bodemverbeterend middel kunnen worden aangewend.

B.2.1 Pakket A.2.1

Zuurtegraad, droogrest (droge stof), organische stof en geleidbaarheid zijn relevante parameters om de bodemverbeterende eigenschappen van het materiaal te kunnen inschatten. Voor het gebruik als meststof maar ook voor de beoordeling van de compostings- en vergistingsprocessen zijn totale stikstof, nitraat- en ammoniakale stikstof belangrijke parameters. De parameter difosforpentoxide wordt zeker in de toekomst relevanter in het kader van de fosfaatverzadiging van landbouwgronden.

In de Vlaamse regelgeving voor het gebruik van materialen als meststof/bodemverbeterend middel (VLAREMA) zijn ondermeer de zware metalen genormeerd terwijl de parameters voor de positieve eigenschappen als bodemverbeteraar/meststof niet rechtstreeks genormeerd zijn. In het Algemeen Reglement van de Certificering voor gft- en groencompost of voor het eindmateriaal van de biologische behandeling van organisch-biologische afvalstoffen (OBA) zijn bepaalde eigenschappen wel genormeerd. Dit Algemeen Reglement is in toepassing van de Vlaamse regelgeving verplicht. Om een juiste beoordeling van alle potentiële stoffen te kunnen maken is ook voor deze laatste parametergroep de correcte bepaling noodzakelijk.

Zoals aangegeven in CMA/5/B.1 kunnen de volgende parameters gemeten worden op de verschillende hoofdmatrices.

PARAMETER	HOOFDMATRIX		
	Vloeibaar	Pasteus	Vast
Vocht/droogrest	X	X	X
Organische stof	X	X	X
pH, elektrische geleidbaarheid, ammonium-N, nitraat-N, totale N	X	X	X
Totaal gehalte aan elementen (zware metalen incl. Hg, P, Ca, K, Mg)	X	X	X

Voor materialen die als meststof/bodemverbeterend middel kunnen worden aangewend, dient de destructie te worden uitgevoerd conform CMA/2/IV/6 (§5.3, §5.5 en §5.6) met uitzondering van vloeibare monsters met een droge stofgehalte < 2%. Deze worden behandeld als een afvalwater en ontsloten conform WAC/III/B/002.

B.2.2 Pakket A.2.2

Dit pakket bevat alle genormeerde parameters voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel zoals opgenomen in VLAREMA 6 en van kracht vanaf 4 maart 2018. VLAREMA 6 (BS 23 februari 2018) wijzigde de criteria voor grondstoffen. Deze criteria zijn opgenomen in bijlage 2.3.1.A., bijlage 2.3.1.B. en bijlage 2.3.1.C. De conformiteit van de meststof of bodemverbeterend middel met de normering moet ten laatste op 4 maart 2019 aangetoond worden.

B.2.3 Pakket A.2.3

De parameters, uitgezonderd stabiliteit met gesloten respirometer, werden oorspronkelijk enkel op compoststalen gemeten. Door de verschillende verwerkingstechnieken op afvalstromen ontstaan zeer diverse materialen waarvoor de bepaling van sommige parameters niet of minder relevant is. In dergelijke situatie is de validatie dan ook niet noodzakelijk. Zoals aangegeven in CMA/5/B.1 kunnen de volgende parameters gemeten worden op de verschillende hoofdmatrices.

PARAMETER	HOOFDMATRIX			MONSTERTYPE
	Vloeibaar	Pasteus	Vast	
Steentjes > 5 mm, Verontreiniging > 2 mm en Repiometrische proef Kiemkrachtige zaden	X	X	X	Uitgezonderd voor monsters met droge stof gehalte < 2%
Rijpheidsgraad			X	Enkel van toepassing voor compost (Groen-, GFT- en OBA-compost)

B.2.4 Pakket A.2.4

Dit is een nieuw pakket voor de bepaling van PFAS in kader van toetsingswaarden voor gebruik als meststof/bodemverbeterend middel.

B.3 Pakket A.3**B.3.1 Pakket A.3.1**

Pakket A.3.1 is opgeheven met VLAREMA 9 en uitdovend voor de bestaande erkenningen.

B.3.2 Pakket A.3.2

Pakket A.3.2 is opgeheven met VLAREMA 9 en uitdovend voor de bestaande erkenningen.

De vormgegeven bouwstoffen worden niet meer getest met de diffusieproef en maximale beschikbaarheidspreef.

B.3.3 Pakket A.3.3

Pakket voor fysische verontreinigingen.

B.3.4 Pakket A.3.4

Dit is nieuw pakket ter vervanging van pakket A.3.1. met een aantal bijkomende parameters in de uitloegbare fractie via de kolomtest:

metalen: antimoon, barium, molybdeen, vanadium, kobalt, seleen, tin en

anionen: bromide, chloride, fluoride en sulfaat.

B.3.5 Pakket A.3.5

Dit is nieuw pakket (PFAS in bouwstof) als uitbreiding van het volledig pakket A.3.1 of A.3.4

B.4 Pakket A.4

Door de grote verscheidenheid aan mogelijke monstertypes en het feit dat niet alle parameters op deze monster moeten gemeten worden is de differentiatie van parameters naar de relevante hoofdmatrices en submatrices noodzakelijk. Het vroegere analysepakket 4.2.8 is opgeheven zodat ook de PCB moeten gevalideerd worden.

De parameter "vlampunt" moet enkel in de matrix 'olie' geanalyseerd worden zodat de validatie kan beperkt blijven tot het monstertype olie. De parameter 'oplosmiddelen (aspecifiek)' is geen relevante parameter voor de beoordeling van de status 'einde afval' voor de matrix olie en hoeft dan ook niet meer gevalideerd te worden. De parameters 'gloeiverlies en TOC' zijn evenmin relevante parameters voor de matrix 'olie' zodat zij niet op het monstertype olie moeten gevalideerd worden.

Gloeiverlies en TOC zijn belangrijke parameters voor de karakterisatie van verbrandingsresiduen (Vlarem II normen). Beide parameters zijn ook in zuiveringsslib relevant om na te gaan of minstens 50% brandbare stoffen aanwezig zijn. Voor houtafval zijn deze 2 parameters vanuit milieuoogpunt echter niet relevant.

De parameter "benzo(a)pyreen" moet cfr VLAREM II enkel gemeten worden om te verifiëren of houtafval voldoet aan de richtwaarden voor niet-verontreinigd behandeld houtafval. In de matrix 'vaste stof' moet de parameter B(a)p dus enkel in het monstertype 'houtafval' gevalideerd worden. Voor de parameter pentachloorfenol (PCP) kan in de milieuvergunning van een meeverbrandingsinstallatie voor gevaarlijke afvalstoffen een maximumgehalte opgelegd worden. Vermits deze parameter momenteel in geen enkele milieuvergunning voor de meeverbranding is opgenomen en er evenmin een gevalideerde CMA-methode voor PCP-bepaling in andere materialen

dan houtafval bestaat, dient de parameter PCP voorlopig enkel in het monstertype 'houtafval' gevalideerd te worden (cfr richtwaarden houtafval).

Droogrest is een relevante parameter voor alle monstertypes (voor matrix olie is het watergehalte relevant).

De parameters (calorische waarde, F, Cl, S, metalen en EOX) zijn specifiek gericht naar de controle van de input voor verbranding met het oog op de bedrijfsvoering en de meetfrequentie van de emissieparameters. Het monstertype 'as en slakken' kan geschrapt worden. Voor de calorische waarde is de bepaling van de aantoonbaarheidsgrens niet relevant vermits de toetsingswaarde minstens 5 MJ/kg bedraagt.

Het verbranden van PCB-houdend afval is verboden in de cementovens en aangezien olie en shredderafval hoogcalorische afvalstoffen zijn, moeten de laboratoria erkend voor verbranden correct kunnen bepalen of deze afvalstoffen al dan niet PCB-houdend zijn. Shredderafval en olie zijn dan ook relevante matrices voor de validatie van PCB.

In eerste instantie is de verbranding van afvalstoffen met PCB aan te duiden als een verwijderingshandeling. De minimale oventemperatuur wordt bepaald door de norm van 1% voor totaal gehalogeneerde verbindingen met onder andere PCB. Afvalstoffen met meer dan 1% totaal gehalogeneerde verbindingen moeten verbrand bij minimum 1100 °C. De andere afvalstoffen mogen verbrand worden bij een minimum temperatuur van 850 °C.

Belangrijker bij de beoordeling van afvalstoffen die verbrand worden is de Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorfifylen en polychloorterfifylen (PCB's/PCT's) en bijhorend normenkader. Het totaal PCB-gehalte wordt gedefinieerd als 5 maal de som van de gehalten van PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 en PCB-180 (6 congenen). Een afvalstof is PCB-houdend indien het voornoemde totaal PCB-gehalte hoger is dan de grenswaarde van 50 ppm, zoals opgenomen in de Europese Richtlijn 96/59/EG en de daaruit omgezette vigerende Vlaamse wetgeving.

De analyse van PCB moet dienen om een afvalstof al dan niet als PCB-houdend aan te duiden. Voor het gebruik van opgewerkte afgewerkte olie als brandstof (einde afvalcriterium) bedraagt de norm voor totaal PCB gehalte 5 ppm.

Pakket A.4				
PARAMETER	HOOFDMATRIX			MONSTERTYPES
	olie	pasteus	vast	
Droogrest	X	X	X	zie B.1 (1)
Vlampunt	X			Olie
Gloeiverlies		X	X	Zuiveringsslib, as en slakken, shredderafval
TOC		X	X	Zuiveringsslib, as en slakken, shredderafval
Benzo(a)pyreen, PCP			X	houtafval
Calorische waarde	X	X	X	Olie, Zuiveringsslib, houtafval, shredderafval
Chloriden Fluoriden Zwavel	X	X	X	Olie, Zuiveringsslib, houtafval, shredderafval

Pakket A.4				
Metalen	X	X	X	Olie, Zuiveringsslib, houtafval, shredderafval
EOX	X	X	X	Olie, Zuiveringsslib, shredderafval
PCB	X		X	Olie, shredderafval

(1) Voor olie: bepaling van watergehalte

B.5 Pakket A.5

De parameter steekvastheid in het analysepakket A.5 dient niet gevalideerd te worden in de hoofdmatrix 'vaste stoffen' vermits de bepaling van steekvastheid enkel op pasteuze materialen relevant is.

PCB is een genormeerde parameter voor stortplaatsen voor inerte materialen. Voor pakket A.5.2 dient de validatie voor PCB te gebeuren op alle relevante monstertypes van vaste stoffen.

De PAK werden uitgebreid van 10 naar 16 PAK.

B.6 Pakket A.6

De bacteriologische parameters in de eindproducten van verwerkte dierlijke bijproducten moeten gevalideerd worden op een vloeibare fractie en een vaste fractie respectievelijk dierlijk vet en diermeel.

B.7 Pakket A.7

De validatie van asbest gebeurt op gerecycleerd granulaat of op verharding/funderingsmateriaal.

B.8 Pakket B.1, B.4, B.5, B.6, B.7 en B.8

Bodemmaterialen zijn afkomstig uit de bodem en naargelang de manier en de plaats waarop deze materialen aan de bodem onttrokken worden, spreekt men van uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, grondbrij of bentonietslib. De bodemmaterialen zijn in aard en samenstelling vergelijkbare materialen. De droge stof van de bodemmaterialen kan echter sterk verschillen naargelang de plaats van oorsprong. De bodemmaterialen hebben bij gebruik een vergelijkbare milieu-impact behalve voor het aspect water en de eventuele hulpstoffen bij boringen.

Sinds 1 april 2019 bestaat er in de Vlarebo één gebruikskader voor alle bodemmaterialen. De verschillende analysepakketten zijn van toepassing naargelang de aard, herkomst en gebruik van de bodemmaterialen.

Het watergehalte in sediment (bagger- en ruimingsspecie) of bentonietslib/grondbrij is doorgaans veel hoger dan in (uitgegraven) bodem. Dit verschil kan de prestatiekenmerken voor organische parameters op een significante wijze beïnvloeden. Validatie gebeurt daarom ook op de 2 hoofdmatrices.

Het nieuwe pakket B.8 (PFAS in bodem en waterbodem) is een uitbreiding van het volledige pakket B.1 of het volledige pakket B.5.

BIJLAGE C RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT ADDITIE

C.1 ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR ADDITIE

De additie van de component gebeurt proportioneel. Er wordt optimaal tussen 50% en 200% van de in het oorspronkelijk monster aanwezige hoeveelheid toegevoegd.

Het concentratieverschil dient voldoende groot te zijn in verhouding tot de beoogde meetonzekerheid, zonder evenwel de gelijkenis met praktijkmonsters in het gedrang te brengen.

De additie dient zodanig te gebeuren dat er minimale verdunning van het monster (behoud van matrix) optreedt. De verdunning bedraagt bij voorkeur niet meer dan 1% (m/m, v/v of v/m).

De additie dient zodanig uitgevoerd te worden dat de meetonzekerheid op het monster en het geaddieerd monster vergelijkbaar blijven (met behulp van voldoende betrouwbare standaardoplossing, ...).

C.2 SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR ADDEREN VAN VERSCHILLENDE MATRICES VOOR ORGANISCHE PARAMETERS

C.2.1 Adderen aan vaste materialen

Matig vluchtige verbindingen

Afhankelijk van de grootte van de hoeveelheid materiaal, die voor de bepaling ingezet moet worden, moet een volume (ongeveer een tiende van het monstervolume) van een polair oplosmiddel (methanol, 2-propanol, aceton, ...) met een gekende hoeveelheid van te bepalen componenten, worden toegevoegd. Breng deze hoeveelheid niet op één plaats aan maar verdeel over het materiaal. Homogeniseer het monster en laat het oplosmiddel gedurende een voldoende lange tijd aan de lucht verdampen (bijvoorbeeld een nacht). Homogeniseer het monster opnieuw.

Vluchtige verbindingen

Breng een hoeveelheid materiaal in een recipiënt en voeg de hoeveelheid oplosmiddel toe die voor de extractie/ontsluiting nodig is. Voeg vervolgens een gekende, kleine hoeveelheid (< 1 % v/v) van een oplossing met componenten toe. Deze oplossing dient met hetzelfde oplosmiddel aangemaakt te zijn als deze die voor de extractie/ontsluiting wordt gebruikt. Sluit de recipiënt af, homogeniseer en laat gedurende een voldoende lange tijd inwerken (bijvoorbeeld een nacht). Homogeniseer het monster opnieuw.

C.2.2 Adderen aan vloeistoffen

Waterige oplossingen

Indien de componenten voldoende goed oplossen in water (bijv. fenolen, polaire pesticiden, ...) wordt in het monster een klein volume (< 0,1 % v/v) met een gekende hoeveelheid van de te bepalen stoffen gebracht. Deze stoffen dienen opgelost in een met water mengbaar oplosmiddel (methanol, 2-propanol, aceton, ...). Homogeniseer het monster.

Indien het componenten betreft die niet goed in water oplossen, brengt men in het geval van een vloeistof/vloeistof extractie eerst het monster over naar een scheitrechter en voert men nadien de additie (< 0,1 % v/v) uit. Wederom zijn de componenten in een met water mengbaar oplosmiddel opgenomen. Spoel de monsterrecipiënten na met het voor de extractie te gebruiken oplosmiddel.

Een andere mogelijkheid is het toevoegen van een additief waarmee de apolaire componenten in de matrix worden gehouden (bijvoorbeeld: 2-propanol, detergenten, ...). In dit geval kan men werken zoals voor polaire verbindingen aangegeven.

Olie

Voeg aan een gekende hoeveelheid materiaal een kleine hoeveelheid ($< 0,1$ % v/v) oplossing toe met daarin de te bepalen componenten. Gebruik een oplosmiddel dat goed mengbaar is met de te onderzoeken olie (2-propanol, aceton, hexaan, ...). Homogeniseer het monster.

BIJLAGE D MINIMALE EISEN MET BETREKKING TOT RAPPORTAGEGRENZEN

De erkende laboratoria en de VITO hebben in het kader van de ISO 17025 prestatiekenmerken afgeleid voor de parameters die onder de erkenning vallen. Door de VITO werden deze verzameld en verwerkt. Er is bij de verwerking vanuit gegaan dat deze data eveneens de monstervoorbehandeling omvatten. Bij het afleiden van de prestatie-eisen werd geëvalueerd wat in het kader van de wetgeving vereist is en wat analytisch haalbaar is. De resultaten werden besproken in de werkgroepen anorganische en organische parameters.

Indien bij de analyse de minimale rapportagegrens niet kan gehaald worden, moeten aanpassingen aan de analysegang ervoor zorgen dat de minimale rapportagegrens toch bereikt wordt. Deze aanpassingen worden op het analyserapport vermeld. Als de minimale rapportagegrens ondanks de aanpassingen niet kan gehaald worden, wordt de verhoogde rapportagegrens gerapporteerd samen met de doorgevoerde aanpassingen.

D.1 Pakket A.2.1 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – monstertype compost

Parameters	Eenheden	GFT KDS ⁽¹⁾	GFT norm	Groen KDS ⁽¹⁾	Groen norm	Rapportage -grens
Vocht	gew.% op vers gewicht	< 50 (<45)	< 55 (<50)	< 50 (<45)	< 55 (50)	-
pH			6,5-9,5		6,5-9,5	-
Organische stof	gew. % op vers gewicht	>16 (>18)	> 14 (>16)	>16 (>18)	> 14 (>16)	-
Totale stikstof	gew.% N op vers gewicht					-
Ammoniakale stikstof	mg NH ₄ -N/l compost op vers gewicht					20
Nitraat stikstof	mg NO ₃ -N/l compost op vers gewicht					10
Geleidbaarheid* bij 25°C *(in 1/5 verdunning)	µS/cm op vers gewicht					-
Zware metalen						
Arseen	mg/kg d.s.	15	20	15	20	2
Cadmium	mg/kg d.s.	1,5	2	1,5	2	0,5
Koper	mg/kg d.s.	90	150	90	150	15
Lood	mg/kg d.s.	120	150	120	150	25
Chroom	mg/kg d.s.	70	70	70	70	15
Nikkel	mg/kg d.s.	20	30	20	30	4
Zink	mg/kg d.s.	300	400	300	400	50
Kwik	mg/kg d.s.	1	1	1	1	0,2
Kiemkrachtige zaden	aantal/l op vers gewicht	1	1	1	1	afwezig
Steentjes > 5 mm	gew.% op vers gewicht	< 2	< 4	< 2	< 4	< 0,05
Verontreinigingen > 2 mm	gew.% op vers gewicht					< 0,05
Verontreinigingen > 2 mm	gew.% op droog gewicht	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,1
Fytotoxiciteit	%	-	-	-	-	< 1
T max	°C	< 40	< 45	< 30	< 40	-

(1) KDS: kwaliteitsdoelstelling

() eis voor VLACO label

D.2 Pakket A.2.1 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – anorganische VLAREMA parameters

	Grondstoffen > 2% droge stof (ds)			Grondstoffen < 2% droge stof per liter (l)		
	Eenheid	Norm Vlarema Besluit Vlaamse Regering 22/12/2017 Bijlage 2.3.1.A	Rapportage- grens	Eenheid	Norm Vlarema Besluit Vlaamse Regering 22/12/2017 Bijlage 2.3.1.B	Rapportage- grens
Arseen	mg/kg ds	20	2	mg/l	0,4	0,04
Cadmium	mg/kg ds	6	0,5	mg/l	0,12	0,01
Chroom	mg/kg ds	150	15	mg/l	3	0,3
Koper	mg/kg ds	800	15	mg/l	16	0,3
Lood	mg/kg ds	300	25	mg/l	6	0,5
Nikkel	mg/kg ds	100	4	mg/l	2	0,08
Zink	mg/kg ds	1500	50	mg/l	30	1
Kwik	mg/kg ds	1	0,2	mg/l	0,02	0,01

D.3 Pakket A.2.2 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – organische parameters

1) Stalen met meer dan 2% droge stof (ds)

	Eenheid	Normw. Vlarema Besluit Vlaamse Regering 22/12/2017 Bijlage 2.3.1.A	1/5 norm	1/2 norm	Rapportage- grens ⁽¹⁾
Hogere chloorbenzenen					
som van 1,2,3,5- tetrachloorbenzenen en 1,2,4,5- tetrachloorbenzenen	mg/kg ds	4	0,8	2	0,4
1,2,3,4- tetrachloorbenzenen	mg/kg ds	2	0,4	1	0,2
pentachloorbenzenen	mg/kg ds	1.5	0,3	0.75	0,15
hexachloorbenzenen	mg/kg ds	0.5	0,1	0.25	0,05
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen					
acenafteen	mg/kg ds	10	2	5	1
acenaftyleen	mg/kg ds	10	2	5	1
antraceen	mg/kg ds	5	1	2,5	0,5
naftaleen	mg/kg ds	3	0,6	1,5	0,3
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	3	0,6	1,5	0,3
fenantreen	mg/kg ds	10	2	5	1
fluorantreen	mg/kg ds	10	2	5	1
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	3	0,6	1,5	0,3
chryseen	mg/kg ds	3	0,6	1,5	0,3
benzo(b)fluorantreen	mg/kg ds	10	2	5	1
benzo(k)fluorantreen	mg/kg ds	5	1	2,5	0,5
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	5	1	2,5	0,5

	Eenheid	Normw. Vlarema Besluit Vlaamse Regering 22/12/2017 Bijlage 2.3.1.A	1/5 norm	1/2 norm	Rapportage- grens ⁽¹⁾
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	5	1	2,5	0,5
dibenzo(a,h)antraceen	mg/kg ds	5	1	2,5	0,5
fluoreen	mg/kg ds	10	2	5	1
pyreen	mg/kg ds	3	0,6	1,5	0,3
Minerale olie					
Fractie C10-C20	mg/kg ds	560	112	280	100
Fractie C20-C40	mg/kg ds	5600	1120	2800	1000
Polychloorbifenylen (som 7 PCB's)					
Som 7 PCB's	mg/kg ds	0,6	0,12	0,3	0,2
PCB 28	mg/kg ds				(0,025)
PCB 52	mg/kg ds				(0,025)
PCB 101	mg/kg ds				(0,025)
PCB 118	mg/kg ds				(0,025)
PCB 153	mg/kg ds				(0,025)
PCB 138	mg/kg ds				(0,025)
PCB 180	mg/kg ds				(0,025)

⁽¹⁾ de rapportagegrenzen van de individuele PCBs zijn toetsingswaarden

2) Stalen met minder dan 2% droge stof per liter

	Eenheid	Normw. Vlarema Besluit Vlaamse Regering 22/12/2017 Bijlage 2.3.1.A	1/5 norm	1/2 norm	Rapportage- grens ⁽¹⁾
Hogere chloorbenzenen					
som van 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen en 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen	µg/l	80	16	40	10
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen	µg/l	40	8	16	5
pentachloorbenzeen	µg/l	30	6	15	5
hexachloorbenzeen	µg/l	10	2	4	2
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen					
acenaftteen	µg/l	200	40	100	40
acenaftyleen	µg/l	200	40	100	40
antraceen	µg/l	100	20	50	20
naftaleen	µg/l	60	12	30	10
benzo(a)pyreen	µg/l	60	12	30	10
fenantreen	µg/l	200	40	100	40
fluoranteen	µg/l	200	40	100	40
benzo(a)antraceen	µg/l	60	12	30	10
chryseen	µg/l	60	12	30	10
benzo(b)fluoranteen	µg/l	200	40	100	40
benzo(k)fluoranteen	µg/l	100	20	50	20
benzo(ghi)peryleen	µg/l	100	20	50	20
indeno(1,2,3-cd)pyreen	µg/l	100	20	50	20

	Eenheid	Normw. Vlarema Besluit Vlaamse Regering 22/12/2017 Bijlage 2.3.1.A	1/5 norm	1/2 norm	Rapportage- grens ⁽¹⁾
dibenzo(a,h)antraceen	µg/l	100	20	50	20
fluoreen	µg/l	200	40	100	40
pyreen	µg/l	60	12	30	10
Minerale olie					
Fractie C10-C20	mg/l	11,2	2,2	5,6	5
Fractie C20-C40	mg/l	112	22,4	56	20
Polychloorbifenylen (som 7 PCB's)					
Som 7 PCB's	µg/l	12	2,4	6	4
PCB 28	µg/l				(0,5)
PCB 52	µg/l				(0,5)
PCB 101	µg/l				(0,5)
PCB 118	µg/l				(0,5)
PCB 153	µg/l				(0,5)
PCB 138	µg/l				(0,5)
PCB 180	µg/l				(0,5)

(1) de rapportagegrenzen van de individuele PCBs zijn toetsingswaarden

D.4 Pakket A.2.4 PFAS in meststof/bodemverbeterend middel

1) Stalen met meer dan 2% droge stof (ds)

Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS)				Rapportagegrens
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	µg/kg ds			3
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	µg/kg ds			3
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	µg/kg ds			2
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	µg/kg ds			2
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	µg/kg ds			2
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	µg/kg ds			1
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	µg/kg ds			1
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	µg/kg ds			1
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	µg/kg ds			1
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTTrDA)	µg/kg ds			1
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	µg/kg ds			1
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	µg/kg ds			2
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	µg/kg ds			1
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	µg/kg ds			1
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	µg/kg ds			1
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	µg/kg ds			1
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	µg/kg ds			3
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	µg/kg ds			1
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	µg/kg ds			1
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	µg/kg ds			3

Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS)				Rapportagegrens
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	µg/kg ds			1
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	µg/kg ds			1
N-methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA)	µg/kg ds			1
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	µg/kg ds			1
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	µg/kg ds			1
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	µg/kg ds			3
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	µg/kg ds			4
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	µg/kg ds			4
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	µg/kg ds			4
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	µg/kg ds			4
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	µg/kg ds			4
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	µg/kg ds			4
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	µg/kg ds			4
6:2/8:2 fluortelomerfosfaat diester (6:2 8:2 diPAP)	µg/kg ds			4
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	µg/kg ds			4
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	µg/kg ds			4
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide acetaat (MePFBSAA)	µg/kg ds			4
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA)	µg/kg ds			4
N-methylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	µg/kg ds			4
N-ethylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	µg/kg ds			4
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	µg/kg ds			4
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	µg/kg ds			4
perfluorooctaanzuur (totaal van lineaire en vertakte) (PFOAtotaal)	µg/kg ds			2
perfluorooctaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte) (PFOSStotaal)	µg/kg ds			3
perfluorooctaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte) (PFOSAtotaal)	µg/kg ds			1
N-methylperfluorooctaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte) (MePFOSAtotaal)	µg/kg ds			1
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte) (EtPFOSAtotaal)	µg/kg ds			3
perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte) (PFHxStotaal)	µg/kg ds			1

2) Stalen met minder dan 2% droge stof (ds)

Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS)				Rapportagegrens
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	ng/l			100
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	ng/l			100
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	ng/l			100
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	ng/l			100
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	ng/l			100
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	ng/l			100
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	ng/l			100
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	ng/l			100
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	ng/l			100
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)	ng/l			100
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	ng/l			100
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	ng/l			100
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	ng/l			100
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	ng/l			100
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	ng/l			100
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	ng/l			100
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	ng/l			100
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	ng/l			100
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	ng/l			100
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	ng/l			100
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	ng/l			100
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	ng/l			100
N-methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA)	ng/l			100
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	ng/l			100
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECBS)	ng/l			100
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	ng/l			100
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	ng/l			100
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	ng/l			100
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	ng/l			100
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	ng/l			100
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	ng/l			100
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	ng/l			100
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	ng/l			100
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 8:2 diPAP)	ng/l			100
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	ng/l			100
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	ng/l			100
N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide acetaat (MePFBSAA)	ng/l			100

Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS)				Rapportagegrens
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA)	ng/l			100
N-methylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	ng/l			100
N-ethylperfluorooctaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	ng/l			100
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	ng/l			100
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	ng/l			100
perfluorooctaanzuur (totaal van lineaire en vertakte) (PFOAtotaal)	ng/l			100
perfluorooctaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte) (PFOSAtotaal)	ng/l			100
perfluorooctaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte) (PFOSAtotaal)	ng/l			100
N-methylperfluorooctaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte) (MePFOSAtotaal)	ng/l			100
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte) (EtPFOSAtotaal)	ng/l			100
perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte) (PFHxStotaal)	ng/l			100

D.5 Pakket A.3.4 Gebruik als bouwstof – pasteus en vast

De rapportagegrenzen zijn van toepassing voor analyse van afvalstoffen voor gebruik als bouwstof volgens Artikel 2.3.2.1 § 1 van Vlarema:

Rekening houdend met de geldende voorwaarden voor het gebruik van bouwstoffen moeten de volgende criteria voor de samenstelling minimaal zijn vervuld om de beoogde grondstoffen te beschouwen als grondstoffen die bestemd zijn voor gebruik als bouwstof :

1° de maximale totaalconcentraties aan organische verbindingen, vermeld in bijlage VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, worden niet overschreden;

2° de maximale totaalconcentraties aan metalen, vermeld in bijlage VI van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, zijn dwingende waarden voor het onvermengd gebruik als niet-vormgegeven bouwstof en voor het vermengd gebruik in niet-vormgegeven bouwstof met druksterkte van minder dan 6,0 N/mm²;

3° de maximale uitloogbaarheidswaarden van de metalen arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink, vermeld in bijlage 2.3.2.B, worden niet overschreden bij het beoogde gebruik in of als bouwstof. De uitloogbaarheidswaarden van barium, bromide, chloride, fluoride en sulfaat, vermeld in bijlage 2.3.2.B, zijn richtwaarden.

In de as van afvalverbranding en de slakken van metallurgie worden bij het beoogde gebruik in of als bouwstof de maximale uitloogbaarheidswaarden van de metalen antimoon, molybdeen, vanadium, kobalt, seleen en tin, vermeld in bijlage 2.3.2.B, niet overschreden.

7° de gerecycleerde granulaten en fysico-chemisch behandelde gerecycleerde granulaten zijn vrijgesteld van de dwingende waarde voor de totaalconcentratie aan metalen. Als voor elk zwaar metaal de totaalconcentratie lager is dan de waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem, vermeld in bijlage V van het VLAREBO, zijn gerecycleerde granulaten en fysico-chemisch behandelde granulaten vrijgesteld van de bepaling van de uitloging van zware metalen.

	Eenheid	Normw. VLAREBO bijlage VI ⁽¹⁾	1/5 norm VLAREBO bijlage VI	Rapportage- grens ⁽²⁾
Zware metalen en metalloïden				
Arseen	mg/kg ds	267	53	10
Cadmium	mg/kg ds	30	6	0,5
Chroom	mg/kg ds	880	176	20
Koper	mg/kg ds	500	100	10
Kwik	mg/kg ds	11	2,2	0,1
Lood	mg/kg ds	1250	250	20
Nikkel	mg/kg ds	530	106	10
Zink	mg/kg ds	1250	250	20
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen				
benzeen	mg/kg ds	0,5	0,1	0,2
tolueen	mg/kg ds	15	3	0,2
ethylbenzeen	mg/kg ds	5	1	0,2
xylenen (som)	mg/kg ds	15	3	0,2
styreen	mg/kg ds	10	2	0,2
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen				
naftaleen	mg/kg ds	6	1,2	0,5
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	7,2	1,4	0,2
fenantreen	mg/kg ds	30	6	0,2
fluoranteen	mg/kg ds	30	6	0,5
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	30	6	0,1
chryseen	mg/kg ds	20	4	0,3
benzo(b)fluoranteen	mg/kg ds	4,4	0,9	0,5
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	10	2	0,5
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	10	2	0,2
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	15	3	0,2
acenaften	mg/kg ds	6,2	1,2	0,5
acenaftyleen	mg/kg ds	1,2	0,24	0,2
antraceen	mg/kg ds	10	2	0,5
dibenzo(a,h)antraceen	mg/kg ds	3,2	0,64	0,5
fluoreen	mg/kg ds	20	4	0,5
pyreen	mg/kg ds	46	9,2	0,5
Alkanen				
hexaan	mg/kg ds	1,2	0,25	0,5
heptaan	mg/kg ds	20	4	1
octaan	mg/kg ds	60	12	1
Minerale olie	mg/kg ds	1000	200	100
Polychloorbifenylen (som 7 PCB's)				
Som 7 PCB's	mg/kg ds	0,5	0,1	0,1
PCB 28	mg/kg ds			(0,015)
PCB 52	mg/kg ds			(0,015)
PCB 101	mg/kg ds			(0,015)
PCB 118	mg/kg ds			(0,015)
PCB 153	mg/kg ds			(0,015)
PCB 138	mg/kg ds			(0,015)
PCB 180	mg/kg ds			(0,015)
Cyanides				
Vrije cyanides	mg/kg ds	5	1	1

	Eenheid	Normw. VLAREBO bijlage VI ⁽¹⁾	1/5 norm VLAREBO bijlage VI	Rapportage- grens ⁽²⁾
Niet-chlooroxideerbare cyanides	mg/kg ds	12	2,4	1

⁽¹⁾ VLAREBO bijlage VI bouwkundig bodemgebruik

⁽²⁾ de rapportagegrenzen van de individuele PCBs zijn toetsingswaarden

Uitloogbaarheid metalen (kolomtest CMA/2/II/A.9.1 bij L/S=10 l/kg ds)						
	Normw. VLAREMA bijlage 2.3.2.B mg/kg ds	Norm µg/l	1/5 norm µg/l	1/2 norm µg/l	RG µg/l	RG mg/kg ds
Arseen	0,8 ⁽¹⁾	80	16	40	15	0,15
Cadmium	0,03 ⁽¹⁾	3	0,6	1,5	1,5	0,015
Chroom	2,6 ⁽¹⁾	260	52	130	10	0,1
Koper	0,8 ⁽¹⁾	80	16	40	10	0,1
Kwik	0,02 ⁽¹⁾	2	0,4	1	0,5	0,005
Lood	1,3 ⁽¹⁾	130	26	65	20	0,2
Nikkel	0,75 ⁽¹⁾	75	15	37,5	10	0,1
Zink	2,8 ⁽¹⁾	280	56	140	50	0,5
Antimoon	1 ⁽¹⁾⁽²⁾	100	20	50	20	0,2
Molybdeen	55 ⁽¹⁾⁽²⁾	5500	1100	2750	20	0,2
Vanadium	2.5 ⁽¹⁾⁽²⁾	250	50	125	20	0,2
Kobalt	0.5 ⁽¹⁾⁽²⁾	50	10	25	10	0,1
Seleen	2 ⁽¹⁾⁽²⁾	200	40	100	40	0,4
Tin	1 ⁽¹⁾⁽²⁾	100	20	50	20	0,2
Barium	20 ⁽³⁾	2000	400	1000	400	4
Bromide	20 ⁽³⁾	2000	400	1000	400	4
Fluoride	55 ⁽³⁾	5500	1100	2750	200	0,2
Chloride	1000 ⁽³⁾	100000	20000	50000	20000	200
Sulfaat	2200 ⁽³⁾	220000	44000	110000	20000	200

⁽¹⁾ dwingende waarde

⁽²⁾ alleen in as van afvalverbranding en in de slakken van metallurgie

⁽³⁾ richtwaarden

Metalen (totaalconcentratie)			
Parameter	Eenheid	Norm	
		Waarden vrij gebruik van uitgegraven bodem Cfr Bijlage V Vlarebo	Rapportagegrens
Arseen	mg/kg ds	35	10
Cadmium	mg/kg ds	1,2	0,5
Chroom	mg/kg ds	91	20
Koper	mg/kg ds	72	10
Kwik	mg/kg ds	1,7	0,1
Lood	mg/kg ds	120	20
Nikkel	mg/kg ds	48	10
Zink	mg/kg ds	200	20

Artikel 2.3.2.1. §2 In afwijking van paragraaf 1 hoeven de materialen, vermeld in bijlage 2.2, afdeling 2, meer bepaald asfaltgranulaat, gerecycleerde bitumineuze granulaten en zeefzand van asfalt, niet te voldoen aan de totaalconcentratie voor de parameter minerale olie en gelden voor de polycyclische aromatische koolwaterstoffen de totaalconcentraties, vermeld in bijlage 2.3.2.A.

Om vast te stellen of voldaan wordt aan voormelde totaalconcentraties, wordt de pak-spraytest gebruikt. Als de pak-spraytest een gele verkleuring vertoont, wordt geacht dat er niet voldaan is aan de voormelde normen. Bij een onduidelijke verkleuring kan een bevestigingsproef met infraroodspectroscopie worden uitgevoerd. Als de infraroodspectroscopie duidelijke pieken vertoont, wordt geacht dat er niet voldaan is aan voormelde normen. Er mag kwalitatief getest worden met infraroodspectroscopie zonder voorafgaande pak-spraytest. Bij twijfel bepaalt een tegenproef met een chemische analyse op pak via GC-MS of de normen in bijlage 2.3.2.A niet zijn overschreden. Het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten vermeldt de proefmethode en de conformiteitscontrole van de pak-spraytest.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen			
Parameter	Eenheid	Norm	
		Normw.VLAREMA bijlage 2.3.2.A	Rapportagegrens
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	35	0,1
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	8,5	0,2
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	35	0,2
benzo(b)fluoranteen	mg/kg ds	55	0,5
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	55	0,5
chryseen	mg/kg ds	400	0,3
fenantreen	mg/kg ds	30	0,2
fluoranteen	mg/kg ds	40	0,5
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	35	0,2
naftaleen	mg/kg ds	20	0,5

D.6 Pakket A.3.3 Fysische verontreinigingen

Parameters	Eenheden	VLAREMA art 2.3.2.1	Rapportagegrens
vlootende verontreinigingen (fractie 4-63 mm) FL	cm ³ /kg ds	5.0	1.0
niet-vlootende verontreinigingen (fractie 4-63 mm) X	% (m/m)	1.0	0.2
Niet-gebonden glas (fractie 4-63 mm) Rg	% (m/m)	2.0	0.2

D.7 Pakket A.4 Verbranden – olie, pasteus en vast

Parameter	Eenheid	Norm of grens- waarde voor olie ⁽¹⁾	RG olie	RG pasteus/ shredder	RG as/slakken	Norm hout	RG hout
Watergehalte	m/m %	0.5	0.4	niet relevant	niet relevant		niet relevant
Sedimentgehalte	m/m%	0.1	0.05				
Vlampunt	°C		40°C	nvt	nvt		nvt
Gloeiverlies	m/m% ds		nvt	niet relevant	niet relevant		nvt
TOC	m/m%C ds		nvt	1%	1%		nvt

Parameter	Eenheid	Norm of grens-waarde voor olie ⁽¹⁾	RG olie	RG pasteus/shredder	RG as/slakken	Norm hout	RG hout
EOX	mg/kg ds		200	200			nvt
Pentachloorfenol (PCP)	mg/kg ds		nvt	nvt	nvt	3	0,6
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds		nvt	nvt	nvt	0,5	0,1
Calorische waarde	mg/kg ds	-	niet relevant	niet relevant	nvt		niet relevant
Chloriden	mg/kg ds	200	50	150	nvt	600	150
Fluoriden	mg/kg ds	-		40	nvt	30	10
Zwavel	mg/kg ds	10000 ⁽²⁾		100	nvt		100
Elementen (totaalconcentratie)							
Cadmium	mg/kg ds	⁽⁴⁾	1	5			
Thallium	mg/kg ds	-	1	20			
Kwik	mg/kg ds	1	0,5	0,5			
Antimoon	mg/kg ds	-	1	20			
Arseen	mg/kg ds	⁽⁴⁾	1	20		2	1
Lood	mg/kg ds	⁽⁴⁾	1	20		90	10
Chroom	mg/kg ds	⁽⁴⁾	1	20		30	5
Kobalt	mg/kg ds	⁽⁴⁾	1	20			
Koper	mg/kg ds	⁽⁴⁾	1	20		20	5
Mangaan	mg/kg ds	⁽⁴⁾	1	20			
Nikkel	mg/kg ds	⁽⁴⁾	1	20			
Vanadium	mg/kg ds	-	1	20			
Tin	mg/kg ds	⁽⁴⁾	1	20			
Zink	mg/kg ds	15 ⁽³⁾	1				
Calcium	mg/kg ds	30 ⁽³⁾	10				
Fosfor	mg/kg ds	15 ⁽³⁾	7.5				

Nvt: niet van toepassing

- (1) VLAREMA Bijlage 2.3.3. Samenstellingsvoorwaarden maximumgehalten aan verontreinigende stoffen voor opgewerkte afvalolie en opgewerkte brandstofresten
- (2) of lager als het S-gehalte in de geldende productnormering lager is dan 1% (m/m)
- (3) als de combinatie Ca en Zn of Ca en P de vermelde maximumgehalten overschrijdt, wordt de afvalolie niet als opgewerkt beschouwd.
- (4) $\sum (\text{As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Pb, Ni, Sn}) < 25 \text{ mg/kg}$. Voor de berekening van de som van deze elementen wordt het gehalte per element lager dan de rapportagegrens gelijk gesteld aan 0 (lower bound benadering).

Parameter	Eenheid	Grenswaarde PCB-houdend	1/5 Grenswaarde	Rapportagegrens ⁽¹⁾
Totaal PCB ⁽²⁾	mg/kg ds	50	10	10
Som van de 6 merker PCB	mg/kg ds	10	2	2
PCB 28	mg/kg ds			(0,3)
PCB 52	mg/kg ds			(0,3)
PCB 101	mg/kg ds			(0,3)
PCB 138	mg/kg ds			(0,3)
PCB 153	mg/kg ds			(0,3)
PCB 180	mg/kg ds			(0,3)

⁽¹⁾ de rapportagegrenzen voor individuele merker-PCBs zijn indicatief

⁽²⁾ het totaal PCB-gehalte wordt gedefinieerd als 5 maal de som van de gehalten van PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 en PCB-180 (6 congenen). Bij het berekenen van de som worden individuele PCB gehalten kleiner dan de rapportagegrens gelijkgesteld aan 0.

Parameter (in matrix olie)	Eenheid	Normwaarde VLAREMA bijlage 2.3.3 ⁽³⁾	1/5 Grenswaarde	Rapportagegrens ⁽¹⁾
Totaal PCB ⁽²⁾	mg/kg ds	5	1	1
PCB 28	mg/kg ds			(0,1)
PCB 52	mg/kg ds			(0,1)
PCB 101	mg/kg ds			(0,1)
PCB 138	mg/kg ds			(0,1)
PCB 153	mg/kg ds			(0,1)
PCB 180	mg/kg ds			(0,1)

⁽¹⁾ de rapportagegrenzen voor individuele merker-PCBs zijn indicatief

⁽²⁾ het totaal PCB-gehalte wordt gedefinieerd als 5 maal de som van de gehalten van PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 en PCB-180 (6 congenen). Bij het berekenen van de som worden individuele PCB gehalten kleiner dan de rapportagegrens gelijkgesteld aan 0.

⁽³⁾ VLAREMA Bijlage 2.3.3. Samenstellingsvoorwaarden maximumgehalten aan verontreinigende stoffen voor opgewerkte afvalolie en opgewerkte brandstofresten

D.8 Pakket A.5.1 stortplaatsen – pasteus en vast

Parameter	Eenheid	Normw	1/5 norm	1/2 norm	Rapportagegrens
Droogrest	m/m%				niet relevant
Minerale olie met GC-FID	mg/kg ds	500	100	250	100
TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR	m/m % DS	2	0,4	1	0,1
Oplosmiddelen (aspecifiek)	%	1	0,2	0,5	0,2
EOX	mg Cl/kg ds	1000	200	500	200
Gloeiverlies	m/m % ds	10%	2	5	2
Totaal organische koolstof (TOC)	m/m% C ds	3			1
Steekvastheid	kN/m2	10	2	5	2

1-stapsschudproef (CMA/2/II/A.12) met bepaling in eluaat van:					
Parameter	Eenheid	Normw	1/5 norm	1/2 norm	Rapportage- grens
pH	-				niet relevant
Arseen	µg/l	50	10	25	15
Barium	µg/l	2000	400	1000	400
Lood	µg/l	50	10	25	20
Cadmium	µg/l	4	0,8	2	1,5
Chroom totaal	µg/l	50	10	25	10
Chroom VI	µg/l	500	100	250	100
Koper	µg/l	200	40	100	40
Nikkel	µg/l	40	8	20	10
Kwik	µg/l	1	0,2	0,5	0,5
Zink	µg/l	400	80	200	50
Molybdeen	µg/l	50	10	25	15
Antimoon	µg/l	6	1,2	3	3
Seleen	µg/l	10	2	5	5
Fluoride	mg/l	1	0,2	0,5	0,2
Cyanide	mg/l	1	0,2	0,5	0,2

mg/kg ds bij L/S 10
niet relevant
0,15
4
0,2
0,015
0,1
1
0,4
0,1
0,005
0,5
0,15
0,03
0,05
2
2

1-stapsschudproef (CMA/2/II/A.12) met bepaling in eluaat van:						
Parameter	Eenheid	Normw	1/5 norm	1/2 norm	Rapportagegrens	mg/kg ds bij L/S 10
Chloride	mg/l	80	16	40	20	200
Sulfaat	mg/l	100	20	50	20	200
Ammonium	mg/l	1000	200	500	200	2000
Nitriet	mg/l	30	6	3	6	60
Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS)	mg/l	400	80	200	100	1000
Opgeloste organ. koolstof (DOC)	mg/l	50	10	25	10	100
Fenolindex	µg/l	100	20	50	20	0.2

D.9 Pakket A.5.2 stortplaatsen – pasteus en vast

Parameter	Eenheid	Normw ⁽¹⁾	1/5 norm	1/2 norm	Rapportagegrens
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen					
Som BTEX	mg/kg ds	6	1,2	3	1
Benzeen	mg/kg ds	0,5	0,1	0,25	0,2
Tolueen	mg/kg ds	6	1,2	3	0,2
Ethylbenzeen	mg/kg ds	5	1	2,5	0,2
Xylenen (som)	mg/kg ds	6	1,2	3	0,2
Styreen	mg/kg ds	1,5	0,3	0,75	0,2
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen					
Naftaleen	mg/kg ds	6	1,2	3	0,5
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	7,2	1,4	3,6	0,2
Fenantreen	mg/kg ds	30	6	15	0,2
Fluoranteen	mg/kg ds	30	6	15	0,5
Benzo(a)antraceen	mg/kg ds	30	6	15	0,1
Chryseen	mg/kg ds	20	4	10	0,3
Benzo(b)fluoranteen	mg/kg ds	4,4	0,9	2,2	0,5
Benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	10	2	5	0,5
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	10	2	5	0,2
Indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	15	2	7,5	0,2
Acenafteen	mg/kg ds	6,2	1,2	3,1	0,5
Acenaftyleen	mg/kg ds	1,2	0,24	0,6	0,2
Anthraceen	mg/kg ds	10	2	5	0,5
Dibenzo(a,h)anthraceen	mg/kg ds	3,2	0,64	1,6	0,5
Fluoreen	mg/kg ds	20	4	10	0,5
Pyreen	mg/kg ds	46	9,2	23	0,5

(1) inerte en niet-gevaarlijke afvalstoffen

Parameter	Eenheid	Normw.	1/5 Grenswaarde	Rapportagegrens ⁽¹⁾
Totaal PCB (som van de 7)	mg/kg ds	1	0,2	0,2
PCB 28	mg/kg ds			(0,025)
PCB 52	mg/kg ds			(0,025)
PCB 101	mg/kg ds			(0,025)
PCB 118	mg/kg ds			(0,025)
PCB 138	mg/kg ds			(0,025)
PCB 153	mg/kg ds			(0,025)

Parameter	Eenheid	Normw.	1/5 Grenswaarde	Rapportagegrens ⁽¹⁾
PCB 180	mg/kg ds			(0,025)

⁽¹⁾ de rapportagegrenzen voor individuele merker-PCBs zijn indicatief

D.10 Pakket G.1 Grondwater en B.1 Bodem

GRONDWATER	Eenheid	BSN norm ⁽¹⁾	Richtw. ⁽²⁾	1/5 BSN	1/5 RW	1/2 RW	Rapportagegrens
Metalen							
Arseen	µg/l	20	12	4	2,4	6	10
Cadmium	µg/l	5	3	1	0,6	1,5	1,5
Chroom	µg/l	50	30	10	6	15	10
Koper	µg/l	100	60	20	12	30	20
Kwik	µg/l	1	0,6	0,2	0,12	0,3	0,2
Lood	µg/l	20	12	4	2,4	6	10
Nikkel	µg/l	40	24	8	4,8	12	10
Zink	µg/l	500	300	100	60	150	50
Chroom(VI)	µg/l						15
Petroleumkoolwaterstoffen							
benzeen	µg/l	10	2	2	0,4	1	1
tolueen	µg/l	700	20	140	4	10	4
ethylbenzeen	µg/l	300	20	60	4	10	4
m+p-xyleen	µg/l						2
o-xyleen	µg/l						1
xylenen (som)	µg/l	500	20	100	4	10	
styreen	µg/l	20	10	4	2	5	2
MTBE	µg/l	300	20	60	4	10	4
Minerale olie	µg/l	500	300	100	60	150	100
Gechloreerde solventen							
dichloormethaan	µg/l	20	5	4	1	2,5	2,5
tetrachloormethaan	µg/l	2	1,2	0,4	0,2	0,6	0,6
tetrachlooretheen	µg/l	40	5	8	1	2,5	1
trichlooretheen	µg/l	70	5	14	1	2,5	1
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	500	5	100	1	2,5	1
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	12	5	2,4	1	2,5	1
1,1-dichloorethaan	µg/l	330	5	66	1	2,5	1
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l						1,2
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l						1,2
1,2-dichloorethenen (som)	µg/l		5		1	2,5	
1,2-dichloorethaan	µg/l	30	5	6	1	2,5	1
vinylchloride	µg/l	5	2	1	0,4	1	1
trichloormethaan	µg/l	200	5	40	1	2,5	1
monochloorbenzeen	µg/l	300	5	60	1	2,5	1
1,2-dichloorbenzeen	µg/l	1000	5	200	1	2,5	1
1,3-dichloorbenzeen	µg/l	1000	5	200	1	2,5	1
1,4-dichloorbenzeen	µg/l	300	5	60	1	2,5	1

GRONDWATER	Eenheid	BSN norm ⁽¹⁾	Richtw. ⁽²⁾	1/5 BSN	1/5 RW	1/2 RW	Rapportagegrens
Matig vluchtige chloorbenzenen							
1,2,3-trichloorbenzeen ⁽³⁾	µg/l	20	5	4	1	2,5	1
1,2,4-trichloorbenzeen ⁽³⁾	µg/l	20	5	4	1	2,5	1
1,3,5-trichloorbenzeen ⁽³⁾	µg/l	20	5	4	1	2,5	1
trichloorbenzenen (som) ⁽³⁾	µg/l						
1,2,3,5+1,2,4,5-tetrachloorbenzeen	µg/l	18	10	3,6	2	5	2
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen	µg/l	9	5	1,8	1	2,5	1
tetrachloorbenzenen (som)	µg/l						
pentachloorbenzeen	µg/l	2,4	1,4	0,5	0,3	0,7	0,3
hexachloorbenzeen	µg/l	1	0,6	0,2	0,1	0,3	0,1
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen							
naftaleen	µg/l	60	20	12	4	10	2
benzo(a)pyreen	µg/l	0,7	0,4	0,14	0,1	0,2	0,1
fenantreen	µg/l	120	20	24	4	10	1
fluoranteen	µg/l	4	2	0,8	0,4	1	0,2
benzo(a)antraceen	µg/l	7	2	1,4	0,4	1	0,2
chryseen	µg/l	1,5	0,9	0,3	0,2	0,5	0,1
benzo(b)fluoranteen	µg/l	1,2	0,7	0,24	0,1	0,4	0,1
benzo(k)fluoranteen	µg/l	0,76	0,4	0,15	0,1	0,2	0,1
benzo(ghi)peryleen	µg/l	0,26	0,1	0,05	0,02	0,05	0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen	µg/l	0,1	0,06	0,2	0,01	0,03	0,03
antraceen	µg/l	75	20	15	4	10	0,5
fluoreen	µg/l	120	20	24	4	10	0,5
dibenzo(a,h)antraceen	µg/l	0,5	0,3	0,1	0,06	0,15	0,06
acenaftteen	µg/l	180	20	36	4	10	0,5
acenaftyleen	µg/l	70	20	14	4	10	0,5
pyreen	µg/l	90	20	18	4	10	0,5
Cyaniden							
Cyanide-totaal	µg/l	70	40	14	8	20	10
Organochloorpesticiden							
aldrin	µg/l						0,01
dieldrin	µg/l						0,01
aldrin+dieldrin	µg/l	0,03	0,02	0,006	0,004	0,01	
cis-chloordaan	µg/l						0,03
trans-chloordaan	µg/l						0,03
chloordaan (cis+trans)	µg/l	0,2	0,12	0,04	0,024	0,06	
o,p'-DDD	µg/l						0,04
p,p'-DDD	µg/l						0,04
o,p'-DDE	µg/l						0,04
p,p'-DDE	µg/l						0,04
o,p'-DDT	µg/l						0,04
p,p'-DDT	µg/l						0,04
DDD+DDE+DDT	µg/l	2	1,2	0,4	0,24	0,6	

GRONDWATER	Eenheid	BSN norm ⁽¹⁾	Richtw. ⁽²⁾	1/5 BSN	1/5 RW	1/2 RW	Rapportage-grens
lindaan (α-isomeer)	µg/l	0,06	0,03	0,01	0,006	0,015	0,02
lindaan (β-isomeer)	µg/l	0,2	0,12	0,04	0,024	0,06	0,025
lindaan (γ-isomeer)	µg/l	2	1,2	0,4	0,24	0,6	0,25
α-endosulfan	µg/l						0,07
β-endosulfan	µg/l						0,07
endosulfansulfaat	µg/l						0,07
endosulfan(α+β+sulfaat)	µg/l	1,8	1	0,36	0,2	0,5	
Trimethylbenzenen							
1,2,3-trimethylbenzeen	µg/l	150	-	30	-	-	10
1,2,4-trimethylbenzeen	µg/l	150	-	30	-	-	10
1,3,5-trimethylbenzeen	µg/l	150	-	30	-	-	10
Chloorfenolen							
2,4,6-trichloorfenol	µg/l	200	-	40	-	-	1
pentachloorfenol	µg/l	9	-	1,8	-	-	1
2-chloorfenol	µg/l	15	-	3	-	-	1
2,4-dichloorfenol	µg/l	9	-	1,8	-	-	1
2,4,5-trichloorfenol	µg/l	300	-	60	-	-	1
2,3,4,6-tetrachloorfenol	µg/l	90	-	18	-	-	1

⁽¹⁾ BSN: bodemsaneringsnorm, bijlage IV Vlarebo 2008: Bodemsaneringsnormen

⁽²⁾ Richtwaarde bijlage II Vlarebo 2008: Richtwaarden voor de bodemkwaliteit

⁽³⁾ Volgens CMA/3/I

BODEM		BSN norm ⁽¹⁾	Richtw. ⁽²⁾ / Vrij gebruik ⁽³⁾	1/5 BSN	1/5 RW	1/2 RW	Rapportage grens
Klei	%	(2%)	(2%)				2%
Organisch materiaal							
Org.mat via TOC bepaling (= 1.72 x TOC gehalte) (TOC)	m/m% ds (m/m% C ds)	(1%) (0.58%)	(1%) (0.58%)				0,35% (0,2%)
Metalen							
Arseen	mg/kg ds	58	35	11,6	7	17,5	10
Cadmium	mg/kg ds	2	1,2	0,4	0,24	0,6	0,5
Chroom	mg/kg ds	130	91	26	18,2	45,5	20
Koper	mg/kg ds	120	72	24	14,4	36	10
Kwik	mg/kg ds	2,9	1,7	0,58	0,34	0,85	0,3
Lood	mg/kg ds	200	120	40	24	60	20
Nikkel	mg/kg ds	93	48	18,6	9,6	24	10
Zink	mg/kg ds	333	200	66,6	40	100	20
Petroleumkoolwaterstoffen							
benzeen	mg/kg ds	0,5	0,3	0,1	0,06	0,15	0,05
tolueen	mg/kg ds	4	1,6	0,8	0,32	0,8	0,3
ethylbenzeen	mg/kg ds	2	0,8	0,4	0,16	0,4	0,15
m+p-xyleen	mg/kg ds						0,1
o-xyleen	mg/kg ds						0,05
xylenen (som)	mg/kg ds	3	1,2	0,6	0,24	0,6	
styreen	mg/kg ds	0,8	0,32	0,16	0,064	0,16	0,05
hexaan	mg/kg ds	1,5	0,6	0,3	0,12	0,3	0,1
heptaan	mg/kg ds	25	10	5	2	5	0,5
octaan	mg/kg ds	75	30	15	6	15	0,5
MTBE	mg/kg ds	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2
Minerale olie	mg/kg ds	1000	300	200	60	150	50
Gechloreerde solventen							
dichloormethaan	mg/kg ds	0,13	0,05	0,026	0,01	0,025	0,025
tetrachloormethaan	mg/kg ds	0,1	0,04	0,02	0,008	0,02	0,02
tetrachlooretheen	mg/kg ds	0,7	0,28	0,14	0,056	0,14	0,05
trichlooretheen	mg/kg ds	0,65	0,26	0,13	0,052	0,13	0,05
1,1,1-trichloorethaan	mg/kg ds	10	4	2	0,8	2	0,5
1,1,2-trichloorethaan	mg/kg ds	0,2	0,08	0,04	0,016	0,04	0,04
1,1-dichloorethaan	mg/kg ds	2	0,08	0,4	0,016	0,04	0,04
cis-1,2-dichlooretheen	mg/kg ds						0,04
trans-1,2-dichlooretheen	mg/kg ds						0,04
1,2-dichloorethenen (som)	mg/kg ds	0,4	0,16	0,08	0,032	0,08	
1,2-dichloorethaan	mg/kg ds	0,1	0,06	0,02	0,012	0,03	0,03
vinylchloride	mg/kg ds	0,1	0,06	0,02	0,012	0,03	0,03
trichloormethaan	mg/kg ds	0,1	0,06	0,02	0,012	0,03	0,03
monochloorbenzeen	mg/kg ds	2,5	1	0,5	0,2	0,5	0,2
1,2-dichloorbenzeen	mg/kg ds	35	14	7	2,8	7	0,5
1,3-dichloorbenzeen	mg/kg ds	40	16	8	3,2	8	0,5
1,4-dichloorbenzeen	mg/kg ds	4	1,6	0,8	0,32	0,8	0,3

BODEM		BSN norm ⁽¹⁾	Richtw. ^{(2)/ Vrij gebruik⁽³⁾}	1/5 BSN	1/5 RW	1/2 RW	Rapportagegrens
Matig vluchtige chloorbenzenen							
1,2,3-trichloorbenzeen	mg/kg ds	0,5	0,2	0,1	0,04	0,1	0,04
1,2,4-trichloorbenzeen	mg/kg ds		0,2		0,04	0,1	0,04
1,3,5-trichloorbenzeen	mg/kg ds		0,2		0,04	0,1	0,04
trichloorbenzenen (som)	mg/kg ds						
1,2,3,5+1,2,4,5-tetrachloorbenzeen	mg/kg ds	0,1	0,08	0,02	0,016	0,04	0,04
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen	mg/kg ds		0,04			0,02	0,02
Tetrachloorbenzenen (som)	mg/kg ds						
pentachloorbenzeen	mg/kg ds	0,5	0,2	0,1	0,04	0,1	0,04
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	0,1	0,06	0,02	0,012	0,03	0,03
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen							
naftaleen	mg/kg ds	1,5	0,3	0,3	0,06	0,15	0,15
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,5	0,3	0,1	0,06	0,15	0,06
fenantreen	mg/kg ds	60	15	12	3	7,5	0,2
fluoranteen	mg/kg ds	20	2	4	0,4	1	0,2
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	5	3,9	1	0,78	2	0,2
chryseen	mg/kg ds	10	2,5	2	0,5	1,25	0,2
benzo(b)fluoranteen	mg/kg ds	2	1,1	0,4	0,22	0,55	0,1
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	1	0,6	0,2	0,12	0,3	0,1
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	160	0,3	32	0,06	0,15	0,15
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	1	0,7	0,2	0,14	0,35	0,1
antraceen	mg/kg ds	3	2,4	0,6	0,5	1,2	0,1
fluoreen	mg/kg ds	45	9,5	9	1,9	4,7	0,1
dibenzo(a,h)antraceen	mg/kg ds	0,5	0,3	0,1	0,06	0,15	0,06
acenaftteen	mg/kg ds	9	3,1	1,8	0,62	1,5	0,1
acenaftyleen	mg/kg ds	1	0,6	0,2	0,12	0,3	0,1
pyreen	mg/kg ds	125	21	25	4	10	0,2
Cyaniden							
Cyanide-totaal	mg/kg ds						
Cyanide-vrije	mg/kg ds	5	3	1	0,6	1,5	1
Cyanide-niet-chl.ox. (Tot.CN-vrije CN)	mg/kg ds	5	3	1	0,6	1,5	1
Trimethylbenzenen							
1,2,3-trimethylbenzeen	mg/kg ds	0,81	-	0,16	-	-	0,1
1,2,4-trimethylbenzeen	mg/kg ds	1,3	-	0,26	-	-	0,1
1,3,5-trimethylbenzeen	mg/kg ds	0,61	-	0,12	-	-	0,1
Chloorfenolen							
2,4,6-trichloorfenol	mg/kg ds	0,64	-	0,13	-	-	0,1
pentachloorfenol	mg/kg ds	0,25	-	0,05	-	-	0,1
2-chloorfenol	mg/kg ds	3,93	-	0,79	-	-	0,1
2,4-dichloorfenol	mg/kg ds	0,67	-	0,13	-	-	0,1
2,4,5-trichloorfenol	mg/kg ds	24	-	4,8	-	-	0,1
2,3,4,6-tetrachloorfenol	mg/kg ds	1,79	-	0,36	-	-	0,1

⁽¹⁾ BSN: bodemsaneringsnorm bestemmingstype 1, bijlage IV Vlarebo 2008: Bodemsaneringsnormen

⁽²⁾ Bijlage II: Vlarebo 2008: Richtwaarden voor de bodemkwaliteit

⁽³⁾ Bijlage V Vlarebo 2008: Waarden voor vrij gebruik van bodemmateriëlelen

D.11 Pakket A.7 Asbest

De rapportagegrens bedraagt 2 mg/kg ds in het geval geen asbest wordt gevonden en bedraagt 20 mg/kg ds indien een kleine hoeveelheid (< 2 mg/kg) niet-hechtgebonden asbest wordt gedetecteerd.

D.12 Pakket B.4 Asbest in bodem

De rapportagegrens bedraagt 2 mg/kg ds in het geval geen asbest wordt gevonden en bedraagt 20 mg/kg ds indien een kleine hoeveelheid (< 2 mg/kg) niet-hechtgebonden asbest wordt gedetecteerd.

D.13 Pakket B.5 Waterbodem

WATERBODEM		BSN norm ⁽¹⁾	Richtw. ⁽²⁾ / Vrij gebruik ⁽³⁾	1/5 BSN	1/5 RW	1/2 RW	Rapportagegrens
Klei	%	(2%)	(2%)				2%
Organisch materiaal							
Org.mat.- TOC	%	(1%)	(1%)				1%
Metalen							
Arseen	mg/kg ds	58	35	11,6	7	17,5	10
Cadmium	mg/kg ds	2	1,2	0,4	0,24	0,6	0,5
Chroom	mg/kg ds	130	91	26	18,2	45,5	20
Koper	mg/kg ds	120	72	24	14,4	36	10
Kwik	mg/kg ds	2,9	1,7	0,58	0,34	0,85	0,3
Lood	mg/kg ds	200	120	40	24	60	20
Nikkel	mg/kg ds	93	48	18,6	9,6	24	10
Zink	mg/kg ds	333	200	66,6	40	100	20
Petroleumkoolwaterstoffen							
benzeen	mg/kg ds	0,5	0,3	0,1	0,06	0,15	0,05
tolueen	mg/kg ds	4	1,6	0,8	0,32	0,8	0,3
ethylbenzeen	mg/kg ds	2	0,8	0,4	0,16	0,4	0,15
m+p-xyleen	mg/kg ds						0,1
o-xyleen	mg/kg ds						0,05
xylenen (som)	mg/kg ds	3	1,2	0,6	0,24	0,6	
styreen	mg/kg ds	0,8	0,32	0,16	0,064	0,16	0,05
hexaan	mg/kg ds	1,5	0,6	0,3	0,12	0,3	0,1
heptaan	mg/kg ds	25	10	5	2	5	0,5
octaan	mg/kg ds	75	30	15	6	15	0,5
Minerale olie	mg/kg ds	1000	300	200	60	150	50
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen							
naftaleen	mg/kg ds	1,5	0,3	0,3	0,06	0,15	0,15
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,5	0,3	0,1	0,06	0,15	0,06
fenantreen	mg/kg ds	60	15	12	3	7,5	0,2
fluoranteen	mg/kg ds	20	2	4	0,4	1	0,2
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	5	3,9	1	0,78	2	0,2

WATERBODEM		BSN norm⁽¹⁾	Richtw.^{(2)/} Vrij gebruik⁽³⁾	1/5 BSN	1/5 RW	1/2 RW	Rapportagegrens
chryseen	mg/kg ds	10	2,5	2	0,5	1,25	0,2
benzo(b)fluoranteen	mg/kg ds	2	1,1	0,4	0,22	0,55	0,1
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	1	0,6	0,2	0,12	0,3	0,1
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	160	0,3	32	0,06	0,15	0,15
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	1	0,7	0,2	0,14	0,35	0,1
antraceen	mg/kg ds	3	2,4	0,6	0,5	1,2	0,1
fluoreen	mg/kg ds	45	9,5	9	1,9	4,7	0,1
dibenzo(a,h)antraceen	mg/kg ds	0,5	0,3	0,1	0,06	0,15	0,06
acenafteen	mg/kg ds	9	3,1	1,8	0,62	1,5	0,1
acenaftyleen	mg/kg ds	1	0,6	0,2	0,12	0,3	0,1
pyreen	mg/kg ds	125	21	25	4	10	0,2
Cyaniden							
Cyanide-totaal	mg/kg ds						
Cyanide-vrije	mg/kg ds	5	3	1	0,6	1,5	1
Cyanide-niet-chl.ox. (Tot.CN-vrije CN)	mg/kg ds	5	3	1	0,6	1,5	1
Polychloorbifenylen (PCB)⁽⁴⁾							
Som 7 congenen	mg/kg ds		0,033		0,007	0,017	0,015
PCB 28	mg/kg ds						(0,002)
PCB 52	mg/kg ds						(0,002)
PCB 101	mg/kg ds						(0,002)
PCB 118	mg/kg ds						(0,002)
PCB 153	mg/kg ds						(0,002)
PCB 138	mg/kg ds						(0,002)
PCB 180	mg/kg ds						(0,002)
Organochloorpesticiden							
alfa-HCH	mg/kg ds		0,05				0,01
gamma-HCH	mg/kg ds		0,05				0,01
beta-HCH	mg/kg ds		0,05				0,01
o,p'-DDE	mg/kg ds		0,05				0,01
p,p'-DDE	mg/kg ds		0,05				0,01
o,p'-DDD	mg/kg ds		0,05				0,01
o,p'-DDT	mg/kg ds		0,05				0,01
p,p'-DDD	mg/kg ds		0,05				0,01
p,p'-DDT	mg/kg ds		0,05				0,01
gamma-chloordaan	mg/kg ds		0,05				0,01
alfa-chloordaan	mg/kg ds		0,05				0,01
alfa-endosulfan	mg/kg ds		0,05				0,05
beta-endosulfan	mg/kg ds		0,25				0,05
endosulfansulfaat	mg/kg ds		0,25				0,01
dieldrin	mg/kg ds		0,05				0,01
aldrin	mg/kg ds		0,1				0,02

⁽¹⁾ BSN: bodemsaneringsnorm bestemmingstype 1 bijlage IV Vlarebo 2008: Bodemsaneringsnormen

⁽²⁾ Bijlage II Vlarebo 2008: Richtwaarden voor de bodemkwaliteit

⁽³⁾ Bijlage V Vlarebo 2008: Waarden voor vrij gebruik van bodemmateriële

⁽⁴⁾ De rapportagegrenzen voor individuele merker-PCBs zijn indicatief

D.14 Pakket B.6 Gebruik van bodemmateri len

Parameter	Norm ⁽¹⁾ mg/kg ds	Norm �g/l	1/5 norm �g/l	1/2 norm �g/l	RG �g/l	RG mg/kg ds
Uitloogbaarheidswaarden (CMA/2/II/A.19)						
Arseen	0,3	30	6	15	10	0,1
Cadmium	0,02	2	0,4	1	0,75	0,0075
Chroom	0,1	10	2	5	5	0,05
Koper	0,6	60	12	30	10	0,1
Nikkel	0,2	20	4	10	10	0,1
Lood	0,3	30	6	15	10	0,1
Zink	1	100	20	50	20	0,2
Kwik	0,003	0,3	0,06	0,15	0,15	0,0015

⁽¹⁾ Bijlage VII Vlarebo: Uitloogbaarheidswaarden voor het gebruik van bodemmateri len voor bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product

Parameter	Eenheid	BSN norm	Richtw. ⁽¹⁾	1/5 BSN	1/5 RW	1/2 RW	Rapportagegrens
Polychloorbifenylen (PCB) ⁽²⁾							
Som 7 PCB's	mg/kg ds		0,033		0,007	0,017	0,015
PCB 28	mg/kg ds						(0,002)
PCB 52	mg/kg ds						(0,002)
PCB 101	mg/kg ds						(0,002)
PCB 118	mg/kg ds						(0,002)
PCB 153	mg/kg ds						(0,002)
PCB 138	mg/kg ds						(0,002)
PCB 180	mg/kg ds						(0,002)

⁽¹⁾ Bijlage II Vlarebo 2008 : Richtwaarden voor de bodemkwaliteit

⁽²⁾ De rapportagegrenzen voor individuele merker-PCBs zijn indicatief

D.15 Pakket B.7 Storten van bodemmateri len

Parameter	Eenheid	Normw	1/5 norm	1/2 norm	Rapportagegrens
TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR	m/m % ds	2	0,4	1	0,1
Gloeiverlies	m/m % ds	10%			1%
Oplosmiddelen (aspecifiek)	%	1	0,2	0,5	0,2
EOX	mg Cl/kg ds	1000	200	500	200
Steekvastheid	N/m2	10	2	5	2

1-stapsschudproef (CMA/2/II/A.12) met bepaling in eluaat van:					
Parameter	Eenheid	Normw	1/5 norm	1/2 norm	Rapportagegrens
pH	-				niet relevant
Arseen	�g/l	50	10	25	15
Barium	�g/l	2000	400	1000	400
Lood	�g/l	50	10	25	20
Cadmium	�g/l	4	0,8	2	1,5
Chroom totaal	�g/l	50	10	25	10

mg/kg ds bij L/S 10
niet relevant
0,15
4
0,2
0,015
0,1

1-stapsschudproef (CMA/2/II/A.12) met bepaling in eluaat van:

Parameter	Eenheid	Normw	1/5 norm	1/2 norm	Rapportagegrens	mg/kg ds bij L/S 10
Chroom VI	µg/l	500	100	250	100	1
Koper	µg/l	200	40	100	40	0,4
Nikkel	µg/l	40	8	20	10	0,1
Kwik	µg/l	1	0,2	0,5	0,5	0,005
Zink	µg/l	400	80	200	50	0,5
Molybdeen	µg/l	50	10	25	15	0,15
Antimoon	µg/l	6	1,2	3	3	0,03
Seleen	µg/l	10	2	5	5	0,05
Fluoride	mg/l	1	0,2	0,5	0,2	2
Cyanide	mg/l	1	0,2	0,5	0,2	2
Chloride	mg/l	80	16	40	20	200
Sulfaat	mg/l	100	20	50	20	200
Ammonium	mg/l	1000	200	500	200	2000
Nitriet	mg/l	30	6	3	6	60
Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS)	mg/l	400	80	200	100	1000
Opgeloste organische koolstof (DOC)	mg/l	50	10	25	10	100
Fenolindex	µg/l	100	20	50	20	0.2

D.16 Pakket B.8 PFAS in bodem en waterbodem

Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS)				Rapportagegrens
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTTrDA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	µg/kg ds			0,5

perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFD _o DS)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	µg/kg ds			0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide (MePFOSA)	µg/kg ds			0,5
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (EtPFOSA)	µg/kg ds			0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	µg/kg ds			0,5
N-ethylperfluor-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	µg/kg ds			0,5
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	µg/kg ds			0,5
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	µg/kg ds			0,5
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	µg/kg ds			0,5
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	µg/kg ds			0,5
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	µg/kg ds			0,5
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	µg/kg ds			0,5
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	µg/kg ds			0,5
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	µg/kg ds			0,5
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	µg/kg ds			4
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	µg/kg ds			4
6:2/8:2 fluortelomerfosfaat diester (6:2 8:2 diPAP)	µg/kg ds			4
N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide acetaat (MePFBSAA)	µg/kg ds			4
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	µg/kg ds			4
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	µg/kg ds			4
perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte) (PFOAtotaal)	µg/kg ds			0,5
perfluor-octaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte) (PFOS _{totaal})	µg/kg ds			0,5
perfluor-octaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte) (PFOS _A totaal)	µg/kg ds			0,5
N-methylperfluor-octaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte) (MePFOS _A totaal)	µg/kg ds			0,5
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte) (EtPFOS _A totaal)	µg/kg ds			0,5
perfluor-hexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte) (PFHxS _{totaal})	µg/kg ds			0,5

D.17 Pakket G.2 PFAS in grondwater

Voor de rapportagegrens-eisen van PFAS in grondwater wordt verwezen naar WAC procedure WAC/VI/A/001.

BIJLAGE E MINIMALE EISEN MET BETREKKING TOT MEETONZEKERHEDEN

De erkende laboratoria en de VITO hebben in het kader van de ISO 17025 meetonzekerheden afgeleid voor de analyseparameters die onder de erkenning vallen. Door de VITO werden deze verzameld en verwerkt. Er is bij de verwerking vanuit gegaan dat deze data eveneens de monstervoorbehandeling omvatten exclusief de monsternamen. De resultaten werden besproken in de overeenkomstige werkgroepen.

E.1 Pakket A.2.1 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel - Compost

Parameters	Eenheden	U (%)
Vocht	gew.% op vers gewicht	10%
pH		10%
Organische stof	gew. % op vers gewicht	30%
Totale stikstof	gew.% N op vers gewicht	30%
Ammoniakale stikstof	mg NH ₄ -N/l compost op v.g.	30%
Nitraat stikstof	mg NO ₃ -N/l compost op v.g.	30%
Geleidbaarheid* bij 25°C *(in 1/5 verdunning)	µS/cm op vers gewicht	30%
Zware metalen		
Arseen	mg/kg d.s.	50%
Cadmium	mg/kg d.s.	50%
Koper	mg/kg d.s.	50%
Lood	mg/kg d.s.	50%
Chroom	mg/kg d.s.	50%
Nikkel	mg/kg d.s.	50%
Zink	mg/kg d.s.	50%
Kwik	mg/kg d.s.	50%
Kiemkrachtige zaden	aantal/l op vers gewicht	-
Steentjes > 5 mm	gew.% op vers gewicht	-
Verontreinigingen* > 2 mm	gew.% op vers gewicht	-
Fytotoxiciteit	%	-
T max	°C	7°C ⁽¹⁾

(1) Absolute grens

E.2 Pakket A.2.1 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – zuiveringsslib

Parameter	U %
Zuurtegraad	10%
Droogrest	10%
Organische stof (=gloeiverlies)	30%
Stikstof	30%
Difosforpentoxide	30%

E.3 Pakket A.2.2 Gebruik als meststof/bodemverbeterend middel – organische parameters

Parameter	U (%)
Chloorkoolwaterstoffen	
som van 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen en 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen	50%
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen	50%
pentachloorbenzeen	50%
hexachloorbenzeen	50%
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	
Acenafteen	50%
Acenaftyleen	50%
Antraceen	50%
Naftaleen	50%
Benzo(a)pyreen	50%
Fenantreen	50%
Fluoranteen	50%
Benzo(a)antraceen	50%
Chryseen	50%
Benzo(b)fluoranteen	50%
Benzo(k)fluoranteen	50%
Benzo(ghi)peryleen	50%
Indeno(1,2,3-cd)pyreen	50%
Dibenzo(a,h)antraceen	50%
Fluoreen	50%
Pyreen	50%
Minerale olie	50%
Polychloorbifenylen (som 7 PCB's)	
PCB 28	50%
PCB 52	50%
PCB 101	50%
PCB 118	50%
PCB 153	50%
PCB 138	50%
PCB 180	50%

E.4 Pakket A.3.4 Gebruik als bouwstof – pasteus en vast

Parameter	U %
Metalen (totaalconcentratie)	
Arseen	50%
Cadmium	50%
Chroom	50%
Koper	50%
Kwik	50%
Lood	50%
Nikkel	50%
Zink	50%
Uitloogbaarheid metalen (kolomtest CMA/2/II/A.9.1 bij L/S=10 l/kg ds)	

Parameter	U %
Arseen	70%
Cadmium	70%
Chroom	70%
Koper	70%
Kwik	-
Lood	70%
Nikkel	70%
Zink	70%
Antimoon	-
Barium	-
Molybdeen	-
Vanadium	-
Kobalt	-
Seleen	-
Tin	-
<i>Uitloogbaarheid anionen (kolomtest CMA/2/II/A.9.1 bij L/S=10 l/kg ds)</i>	
Bromide	-
Chloride	-
Fluoride	-
Sulfaat	-

Parameter	U (%)
<i>Monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEXS)</i>	
Benzeen	50%
Tolueen	50%
Ethylbenzeen	50%
Xylenen (som)	50%
Styrene	50%
<i>Alkanen</i>	
n-hexaan	50%
n-heptaan	50%
n-octaan	50%
<i>Polycyclische aromatische koolwaterstoffen</i>	
Naftaleen	50%
Benzo(a)pyreen	50%
Fenantreen	50%
Fluoranteen	50%
Benzo(a)antraceen	50%
Chryseen	50%
Benzo(b)fluoranteen	50%
Benzo(k)fluoranteen	50%
Benzo(ghi)peryleen	50%
Indeno(1,2,3-cd)pyreen	50%
Acenafteen	50%
Acenaftyleen	50%
Antraceen	50%
Dibenzo(a,h)antraceen	50%
Fluoreen	50%

Parameter	U (%)
Pyreen	50%
Minerale olie	50%
Polychloorbifenylen (som 7 PCB's)	
PCB 28	50%
PCB 52	50%
PCB 101	50%
PCB 118	50%
PCB 153	50%
PCB 138	50%
PCB 180	50%
Cyanides	
Vrije cyanide	-
Niet-chlooroxideerbare cyanides	-

E.5 Pakket A.4 Verbranden – olie, pasteus en vast

Parameter	U (%)
Watergehalte	10%
Vlampunt	10%
Gloeiverlies	30%
TOC	30%
Calorische waarde	30%
Chloriden	30%
Fluoriden	50%
Zwavel	50%
Metalen (totaalconcentratie)	
Cadmium	50%
Thallium	50%
Kwik	50%
Antimoon	50%
Arseen	50%
Lood	50%
Chroom	50%
Kobalt	50%
Koper	50%
Mangaan	50%
Nikkel	50%
Vanadium	50%
Tin	50%
EOX	50%
pentachloorfenol	50%
benzo(a)pyreen	50%

	U (%)
Polychloorbifenylen (PCB)	
Som 7 congenen	50%
PCB 28	50%
PCB 52	50%
PCB 101	50%
PCB 118	50%
PCB 153	50%

	U (%)
Polychloorbifenylen (PCB)	
PCB 138	50%
PCB 180	50%

E.6 Pakket A.5.1 Storten – pasteus en vast

Parameter	U (%)
Droogrest	10%
Minerale olie met GC-FID	50%
Oplosmiddelen (aspecifiek)	50%
EOX	50%
Gloeiverlies	30%
Totaal organische koolstof (TOC)	30%
Steekvastheid	-
1-stapsschudproef (CMA/2/II/A.12) met bepaling in eluaat van:	
pH	10%
Arseen	50%
Barium	50%
Lood	50%
Cadmium	50%
Chroom totaal	50%
Chroom VI	50%
Koper	50%
Nikkel	50%
Kwik	50%
Zink	50%
Molybdeen	50%
Antimoon	50%
Seleen	50%
Fluoride	50%
Cyanide	50%
Chloride	50%
Sulfaat	50%
Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS)	50%
Opgeloste organ. koolstof (DOC)	50%

E.7 Pakket A.5.2 Storten – pasteus en vast

Parameter	U (%)
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEXS)	
Benzeen	50%
Tolueen	50%
Ethylbenzeen	50%
Xylenen (som)	50%
Styrene	50%
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	
Naftaleen	50%
Benzo(a)pyreen	50%
Fenantreen	50%
Fluoranteen	50%
Benzo(a)antraceen	50%

Parameter	U (%)
Chrysene	50%
Benzo(b)fluoranteen	50%
Benzo(k)fluoranteen	50%
Benzo(ghi)peryleen	50%
Indeno(1,2,3-cd)pyreen	50%
Acenafteen	50%
Acenaftyleen	50%
Anthraceen	50%
Dibenzo(a,h)anthraceen	50%
Fluoreen	50%
Pyreen	50%
Fenolindex	50%